

Regionalna anestezja

Perifix® – zestawy z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych



Perifix® zestaw z filtrem i strzykawką do metody spadku oporu (LOR)

■ zestawy i elementy do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego

■ elementy:

- Perifix® cewnik wykonany z poliamidu, długość 100 cm, czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy
- Perifix® łącznik do cewnika
- Perican® igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy
- Perifix® EF płaski filtr, 0,2 μ m, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar

		Perican®		Perifix cewnik + łącznik do cewnika						Strzykawki				Igły				
Nr katalogowy zestawu	Kod	G18 x 3 1/4" 1,3 x 80 mm – różowy	G16 x 3 1/4" 1,7 x 80 mm – biały	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G19 – 0,6 x 1,05 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G20 – 0,45 x 085 otwór na końcu cewnika	G19 – 0,6 x 1,05 otwór na końcu cewnika	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Miękka końcówka	Perifix – filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm	Omnifix lock 2 ml	Omnifix lock 10 ml	Omnifix lock 20 ml	Perifix L. O. R. 10 ml, luer	Sterican G25 x 5,8"	Sterican G21 x 1 1/2"	Sterican G18 x 1 1/2"	PIN PAD – system mocowania filtra Perifix	Jednostka handlowa (szt.)
Perifix – zestaw pełny																		
4514203	420	+		+					+	+	+	+		+	+	+	+	10
4514300	430		+		+				+	+	+	+		+	+	+	+	
4516206	620	+				+			+	+	+	+		+	+	+	+	
4510291	900	+						+	+	+	+	+		+	+	+	+	
4514211	421	+		+					+	+		+	+	+	+	+	+	
4514319	431		+				+		+	+		+	+	+	+	+	+	
4510305	901	+						+	+	+		+	+	+	+	+	+	
Perifix – zestaw z filtrem																		
4514009	400	+		+					+									20
4514050	405		+		+				+									
4510216	700	+						+	+									

Perifix® – zestawy z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych



Perifix® zestaw bez filtra

Nr katalogowy zestawu	Kod	Perican®		Perifix cewnik + łącznik do cewnika				Perifix – filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm	Perifix L. O. R. 10 ml, luer – strzykawka do metody spadku oporu	PIN PAD – system mocowania filtra Perifix	Jednostka handlowa (szt.)
		G18 x 3 1/4" 1,3 x 80 mm – różowy	G16 x 3 1/4" 1,7 x 80 mm – biały	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G19 – 0,6 x 1,05 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G20 – 0,45 x 085 otwór na końcu cewnika	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Miękką końcówką				
Perifix – zestaw zewnątrzoponowy z filtrem i strzykawką do metody spadku oporu											
4514017	401	+		+				+	+		
4514513	451	+		+				+	+	+	
4514025	402		+		+			+	+		
4510097	701	+					+	+	+		
4517504	750	+					+	+	+	+	
Perifix – zestaw mini											
4513002	300	+		+							
4513100	310		+		+						
4511000	100	+				+					
Perifix – zestaw mini ze strzykawką do metody spadku oporu											
4513010	301	+		+					+		
4513029	302		+		+				+		

20

Regionalna anestezja

Perifix® mocowanie cewnika stosowanego w regionalnej anestezji wraz opatrunkiem zabezpieczającym



- Perifix® element mocujący, łączy łatwość założenia z bezpieczeństwem utrzymania cewnika
- Wyeliminowana możliwość ruchu cewnika po umocowaniu go pierścieniem mocującym
- Kontrola miejsca wkłucia jest możliwa bez ryzyka zmiany położenia cewnika
- Możliwość wymiany opatrunku przy pozostawieniu elementu mocującego
- Całkowicie płaski i wygodny dla pacjenta system mocowania cewnika

Pełen zestaw mocujący cewnik



Płaski pierścień mocujący





Foliowy opatrunek ze środkową częścią pozbawioną kleju

Nr katalogowy	Produkt	Minimalne zamówienie (szt.)
4511200	Perifix® pełen zestaw mocujący cewnik	25
4511201	Perifix® foliowy opatrunek ze środkową częścią pozbawioną kleju	25


Regionalna anestezja

Espocan® – zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE)

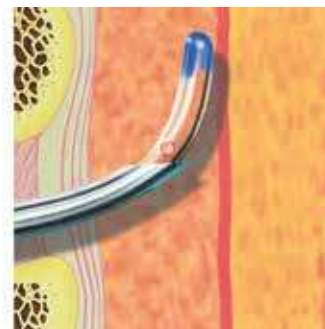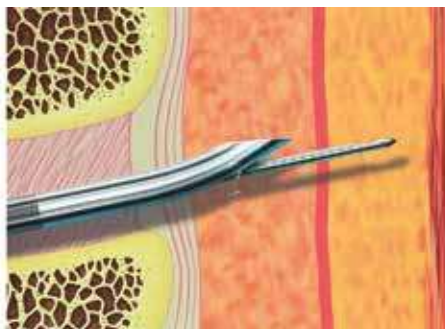

Nr katalogowy	Igła podpajęczynówkowa					Jedn. handlowa (szt)	
	Typ igły podpajeczynówkowej (rodzaj szlif)	Kod kolorów	Rozmiary				
			mm	G	cale		
z cewnikiem Perifix® z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi							
4556666	Pencan® (Pencil Point)	szary	0,42	127,5	27	5"	10
4556674	Spinocan® (Quincke)	szary	0,42	125,5	27	5"	
z cewnikiem z miękką zamkniętą końcówką Perifix® i trzema otworami bocznymi oraz systemem unieruchamiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej (DOCKING SYSTEM)							
4556763	Pencan® (Pencil Point)	szary	0,42	138,5	27	53/8"	10
4556747	Spinocan® (Quincke)	szary	0,42	136,5	27	53/8"	



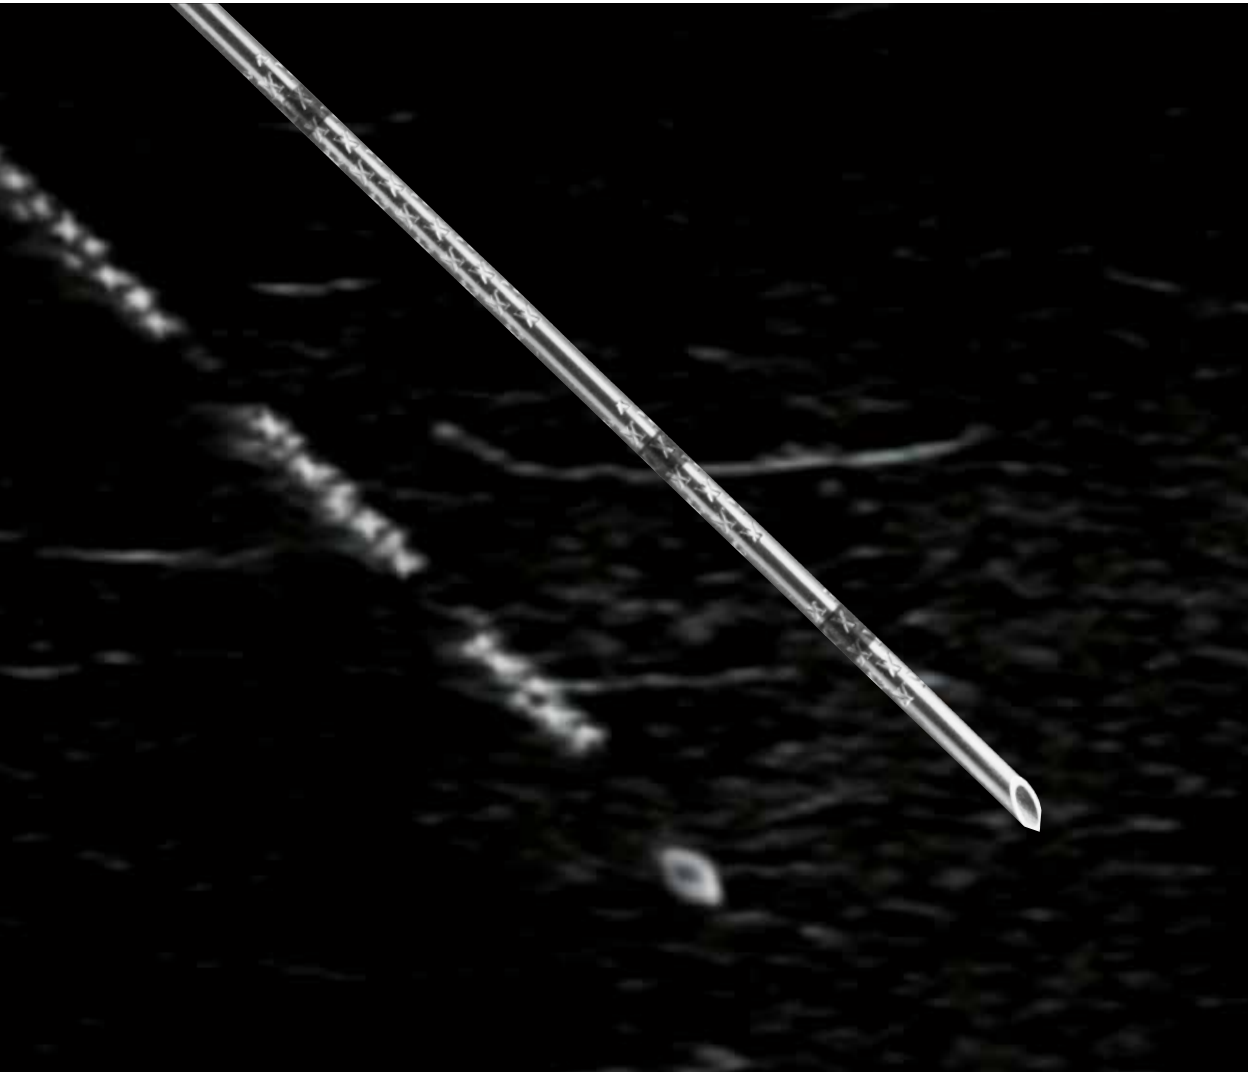

Stimuplex® Ultra 360®
Ultraplex® 360

ULTRALINE 360

Ultraschall geführte Nervenblockaden

SICHTBARKEIT OHNE KOMPROMISS



In die neue Ultraline 360 haben wir all unser Wissen und Erfahrung investiert, um eine Nadel mit ausgezeichneter echogenen Sichtbarkeit zu erzeugen. Ultraline 360 bietet eine sehr gute Sichtbarkeit im Ultraschall mit weniger Artefakten unter Beibehaltung der allgemein anerkannten Punktions- und Gleiteigenschaften.

IHR NUTZEN


- Höchste Sichtbarkeit im Ultraschall durch X-Muster
- Der Safety Code ermöglicht eine einfachere Identifikation sowie Positionierung der Nadel und Nadelspitze
- Optimales Gleit- und Punktionsverhalten durch unsere bewährte Beschichtung und den Stimuplex® 30° Schliff
- Ausgezeichnete Sichtbarkeit von jeder Seite durch eine 360° Anbringung des X-Musters



THE NEXT GENERATION

X-MUSTER: EXTREME SICHTBARKEIT

Die neuen Ultraline 360-Nadeln haben ein unverwechselbares Sicherheits-X-Muster. Die hohe Anzahl an Kanten ermöglicht eine ausgezeichnete Reflektion der Ultraschallwellen, auch bei steilerem Einstichwinkel.

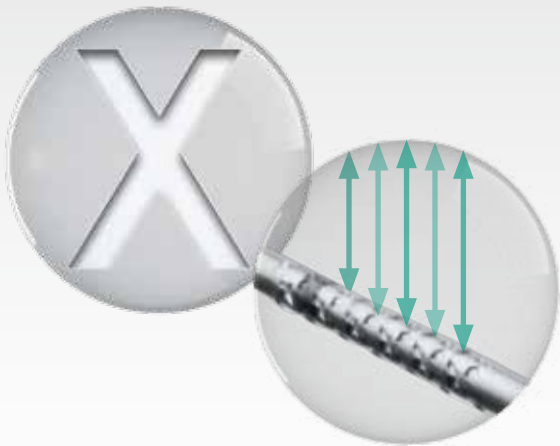

REFLEKTION DER ULTRASCHALLWELLEN


SAFETY CODE

Die B. Braun Ultraline 360 bietet mit ihrem Safety Code eine ideale Unterstützung bei der Lokalisation der Nadelspitze. Das X-Muster ist auf den ersten 20 mm des Nadelschafts platziert. Der in drei Segmente geteilte Code «kurz-kurz-lang» ermöglicht eine optimale Unterscheidung zwischen der Nadelspitze und dem oberen Nadelschaft.




STIMUPLEX® 30° SCHLIFF


SAFETY CODE

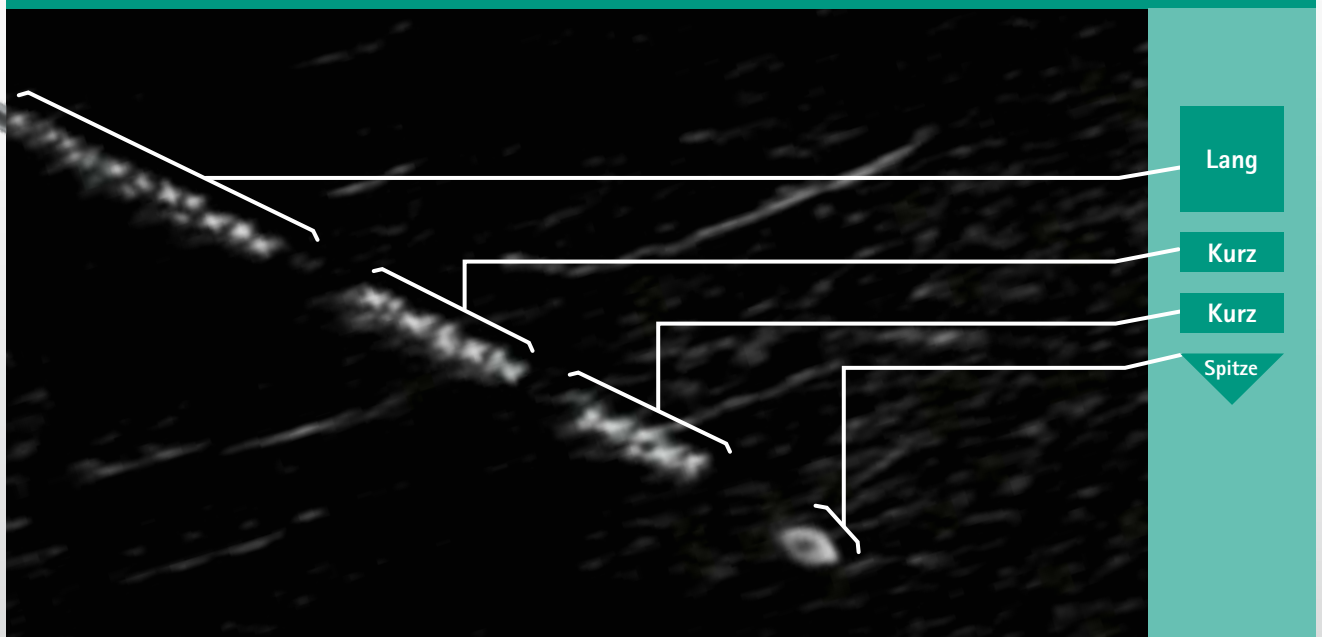

STIMUPLEX® ULTRA 360® / ULTRAPLEX® 360

Ausgezeichnete Sichtbarkeit ohne Kompromiss

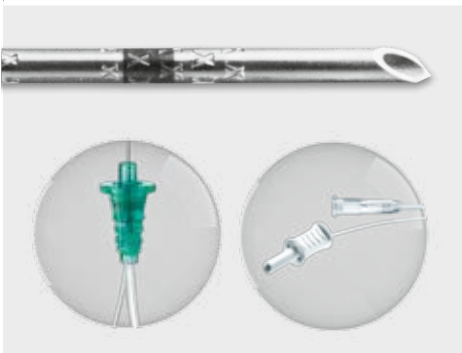Stimuplex® Ultra 360®	Kanüle ø Gauge und Länge (Zoll)	Kanüle ø und Länge (mm)	VE/ Stück	Artikel- nummer	Pharmacode
	Kanülen mit 30° Schliffgeometrie mit Nervenstimulation				
	22 G x 1 ³ / ₈ "	0.70 x 35	25	4892503-01	6502547
	22 G x 2 "	0.70 x 50	25	4892505-01	6502524
	22 G x 3 ¹ / ₈ "	0.70 x 80	25	4892508-01	6502530
	20 G x 4 "	0.90 x 100	25	4892510-01	6502553
	20 G x 6 "	0.90 x 150	25	4892515-01	6502576

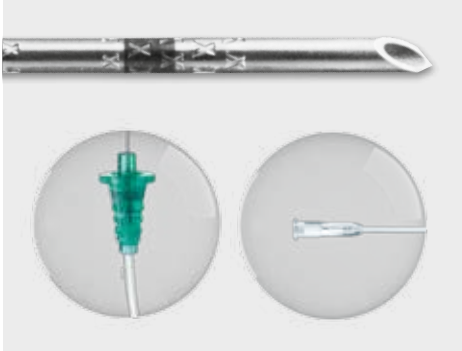Ultraplex® 360	Kanüle ø Gauge und Länge (Zoll)	Kanüle ø und Länge (mm)	VE/ Stück	Artikel- nummer	Pharmacode
	Kanülen mit 30° Schliffgeometrie ohne Nervenstimulation				
	22 G x 1 ³ / ₈ "	0.70 x 35	25	4892603-01	6502636
	22 G x 2 "	0.70 x 50	25	4892605-01	6502582
	22 G x 3 ¹ / ₈ "	0.70 x 80	25	4892608-01	6502599
	20 G x 4 "	0.90 x 100	25	4892610-01	6502607
	20 G x 6 "	0.90 x 150	25	4892615-01	6502613

THE NEXT GENERATION

- 360° Markierung für ausgezeichnete Sichtbarkeit
- Hochwertige, reibungsarme Beschichtung für optimales Gleit- und Punktionsverhalten
- Perfekte Reflektion der Ultraschallwellen durch X-Muster

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com



EZCOVER®

STERYLNA OSŁONA NA GŁOWICĘ

EZCOVER® – zwiększona ochrona pacjenta, użytkownika i sprzętu

Zestaw osłon na głowice ultradźwiękowe



EZCOVER – Ponieważ kontrola infekcji ma znaczenie.

Profilaktyka i kontrola zakażeń to kluczowe priorytety opieki zdrowotnej. Choć ultradźwięki są uważane za jedną z najbezpieczniejszych metod obrazowania, ryzyko przenoszenia infekcji podczas USG są oczywiste.¹ Zastosowanie jałowej osłony i sterylnego żelu do zabiegów z użyciem USG to ważny sposób zapobiegania zakażeniom krzyżowym i zmniejszenia ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną.²

"Należy używać dedykowanych osłon głowicy i jałowego żelu dla wszystkich zabiegów interwencyjnych z użyciem USG"

(Zalecenie Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego Grupa Robocza ds. Ultrasonografii)

WSZYSTKIE ZESTAWY ZAWIERAJĄ:

- Osłonę głowicy – dostępną w różnych rozmiarach (szer. x dł.)
 - 15 x 30 cm
 - 15 x 61 cm
 - 15 x 122 cm
 - 15 x 244 cm
- Sterylny żel (1 x 20g)
- Opaski gumowe(bez lateksu) 2 szt.
- Sterylna niebieska serweta (30 x 30 cm)

EZCOVER. Lepsza ochrona pacjenta, użytkownika i sprzętu.

EZCOVER są sterylne, nie zawierają lateksu i zapewniają maksymalną ochronę pacjenta, użytkownika i sprzętu. EZCOVER są odpowiednie do wszystkich sterylnych i niesterylnych zastosowań ultradźwiękowych.

Łatwe w zakładaniu i wygodne w użyciu.

Teleskopowe składanie pozwala na sterylną aplikację. Czytelna instrukcja na opakowaniu zmniejszają ryzyko błędów i niewłaściwego użycia.

Znakomita jakość obrazu.

Wysokiej jakości materiał miękkiego rękawa naśladuje właściwości tkanki ludzkiej. Elastyczny materiał zapobiega powstawaniu zmarszczek i zapewnia wolną od powietrza powierzchnię skanowania bez zniekształceń obrazu.



KORZYŚCI EZCOVER:

Zwiększona ochrona

- Bez lateksu
- Zatwierdzona do użytku śródoperacyjnego
- Zmniejsza ryzyko błędów proceduralnych (naklejka STOP)

Łatwa w zakładaniu – wygodna w użyciu

- Wygodna obsługa
- Elastyczny materiał – dostosowany do wszystkich głowic
- Wszystkie niezbędne komponenty do natychmiastowego użycia w jednym zestawie


Wyjątkowa jakość materiału

- Miękki i wygodny materiał
- Dopasowanie do głowicy bez zmarszczek i powietrza
- Nie wpływa na jakość obrazu

NOWOŚĆ! Zastanów się, zanim wykonasz blokadę.

Blokady niewłaściwej strony (WSB) są klasyfikowane jako niewystępujące zdarzenia, ale jak się okazuje zdarzają się często.³ Ogólnokrajowa kampania na rzecz bezpieczeństwa pacjentów w Wielkiej Brytanii o nazwie „Stop before you block” ma na celu zmniejszenie częstości występowania nieumyślnych nieprawidłowych blokad nerwów podczas znieczuleń regionalnych.⁴

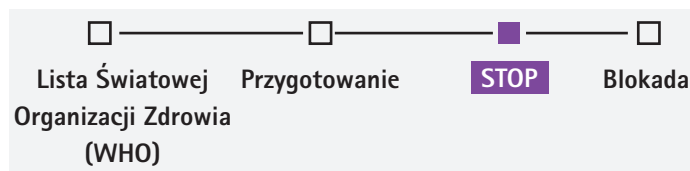


EZCOVER są dostępne z etykietą STOP (Sprawdź). Naklejka przypomina, że lekarz powinien ZATRZYMAĆ SIĘ bezpośrednio przed rozpoczęciem zabiegu i przeprowadzić ostateczne potwierdzenie właściwej strony operacji i miejsca wykonania blokady.



KORZYŚCI:

- Zapewnia zgodność z listą kontrolną WHO (Standardy JCI IPSC4 i IPSC4.1)
- Zmniejsza ryzyko wykonania nieprawidłowych blokad

SPECYFIKACJA

	Nazwa	Rozmiar (szer. x dł. cm)	Opakowanie	Nr kat.
Zestaw podstawowy				
	Zestaw osłony głowicy USG z żelem	15x30	30 szt.	PCG15030
	Zestaw osłony głowicy USG z żelem	15x61	30 szt.	PCG15061
	Zestaw osłony głowicy USG z żelem	15x122	30 szt.	PCG15122
	Zestaw osłony głowicy USG z żelem	15x244	25 szt.	PCG15244
Zestaw z naklejką STOP (Kontrola)				
 	Zestaw osłony głowicy USG z żelem i naklejką STOP	15x30	30 szt.	PCT15030
	Zestaw osłony głowicy USG z żelem i naklejką STOP	15x61	30 szt.	PCT15061
	Zestaw osłony głowicy USG z żelem i naklejką STOP	15x122	30 szt.	PCT15122
	Zestaw osłony głowicy USG z żelem i naklejką STOP	15x244	25 szt.	PCT15244

PIŚMIENNICTWO:

- 1 Sartoretti T, Sartoretti E, Bucher C et al. Bacterial contamination of ultrasound probes in different radiological institutions before and after specific hygiene training: do we have a general hygienical problem? Eur Radiol. 2017 Oct;27(10):4181-4187
- 2 Nyhsen CM, Humphreys H, Koerner RJ et al. Infection prevention and control in ultrasound – best practice recommendations from the European Society of Radiology Ultrasound Working Group. Insights Imaging. 2017 Dec;8(6):523-535
- 3 Cohen SP, Hayek SM, Datta S, Bajwa ZH, Larkin TM, Griffith S, Hobelmann G, Christo PJ, White R. Incidence and root cause analysis of wrong-site pain management procedures: a multi-center study. Anesthesiology. 2010 Mar;112(3):711-8
- 4 <https://www.ra-uk.org/index.php/stop-before-you-block>

Aesculap Chifa sp. z o.o. | 64-300 Nowy Tomyśl | ul. Tysiąclecia 14
Tel. 61 44 20 100 | Fax 61 44 23 936 | www.bbraun.pl

Aesculap Chifa – firma grupy B. Braun

Contiplex® C

Ciągła blokada obwodowa tak prosta jak blokada „single shot”



Regionalna anestezja

Contiplex® C

Oryginalny patent B. Braun



B. Braun Contiplex® C

Każdy pacjent zasługuje na najlepszą z możliwych opiekę przeciwbólową. Regionalna anestezja a w szczególności ciągłe blokady nerwów obwodowych są ważną metodą umożliwiającą prowadzenie terapii przeciwbólowej u pacjenta po odbytej operacji². Jednakże technice ciągłego znieczulenia nerwów obwodowych z użyciem cewnika, często towarzyszą wyzwania takie jak właściwa kontrola położenia cewnika czy ogólna złożoność procedury.³

Contiplex® C jest nowatorskim i opatentowanym systemem umożliwiającym lepsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonanie blokady nerwów obwodowych. Innowacyjny projekt cewnika na igle pomaga przełamać wiele ograniczeń towarzyszących ciągłym metodom blokad nerwów obwodowych.

Zapraszamy Cię do odkrycia możliwości nowej generacji cewników do blokad nerwów obwodowych łączących obie techniki: Tak łatwa jak technika „single shot” z mocą cewnika

- 1. Uchwyt C-Grip**
Unikalny uchwyt dla bezpiecznego wprowadzenia cewnika na igle



- 2. Cewnik Contiplex® C**
ø G19/188 mm

¹ Steinfeldt T. Nerve injury by needle nerve perforation in regional anesthesia: does size matter? Br J Anaesth 2010. 104:245-53

² Richman JM. Does Continuous Peripheral nerve Block Provide Superior Pain Control to Opioids? Anesth Analg 2006. 102:248-57

Evans H. Peripheral Nerve Blocks and Continuous Catheter Techniques. Anesth 2005. 23:142-62

³ Capdevilla X. Infection Risk of Continuous Peripheral Nerve Blocks. Anesthesiology 2009. 110:182-88

Neuburger M. Complications and adverse events in continuous peripheral regional anesthesia. Anaesthesist 2006. 55:33-40

- 3. Izolowana igła Contiplex® C**
ø G25/190 mm


Nowe rozwiązanie umiejscowienia cewnika...

....dla niezawodnej analgezji pooperacyjnej



Korzyści dla użytkownika

- **Stworzony do pracy z USG**
Wprowadzenie igły i cewnika w jednym kroku daje możliwość obsługi głowicy USG drugą ręką jednocześnie. W zestawie cewnik o wysokiej echogeniczności.
- **Pewne umiejscowienie cewnika**
Bardziej precyzyjne i niezawodne położenie cewnika
- **Mniejsza traumatyzacja**
Większa wygoda dla pacjenta, igła o małej średnicy 25G

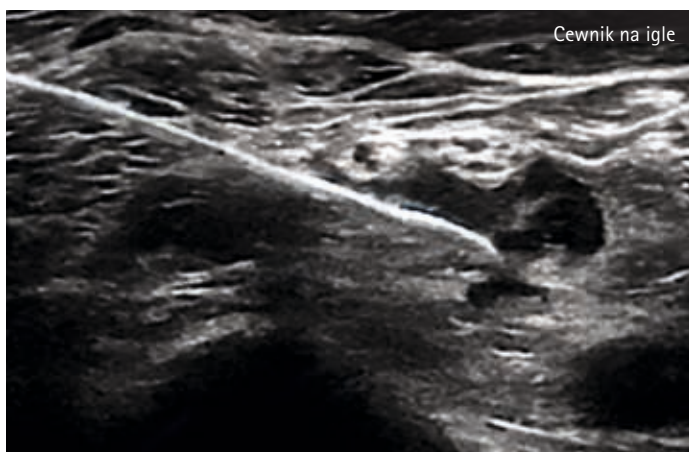

Obraz z USG udostępniony przez Dr S.Bloc, Prywatny Szpital Claude Galien, Francja



Dzięki dwuwarstwowej technologii produkcji cewnika, wtopionych trzech kontrastujących pasach, cewnik może być widoczny, jako dwie równoległe linie w podłużnym widoku obrazu USG.



4. Drenik infuzyjny nie zawierający DEHP
Długość 500 mm

5. Kabelek elektryczny
Długość 500 mm

Nowatorskie rozwiązanie ułatwiające właściwe położenie cewnika.



Krok 1 : Przygotowanie zestawu

Odkręć zielony uchwyt C-Grip od uchwyty igły i przesun w kierunku czubka igły. Złap igłę przez przyciśnięcie uchwyty C-Grip na igłę w odległości 2 cm od szlif igły. Podaj 0, 9% NaCl przez drenik celem usunięcia powietrza z systemu*.



Krok 2: Rozpoczęcie

Wykonaj punkcję i wprowadź igłę z cewnikiem pod kontrolą stymulacji i/lub ultrasonografii. Aby wprowadzić Contiplex® C, zwolnij uścisk na uchwycie C-Grip, przesun go na igłę o kolejne 2 cm od poziomu skóry w kierunku uchwyty igły. Przyciśnij uchwyt C-Grip i wprowadź igłę z cewnikiem w kierunku nerwu.



Krok 3: Umiejscowienie cewnika

Kieruj igłę z cewnikiem aż do uzyskania pożądanego miejsca końca igły. Podaj bolus przez igłę. Trzymając cewnik Contiplex®C za pomocą C-Grip wysuń igłę ze światła cewnika**.

* zasady higieny mogą się różnić w zależności od lokalnych procedur szpitalnych.

** zaleca się wprowadzać cewnik na igłę celem wykonania blokady nerwów obwodowych wprowadzając cewnik po 2 cm pod skórę. System jest dedykowany do wykonania blokad nie głębszych niż 6 cm.



Krok 4: Zakończenie


Zamontuj: łącznik do cewnika, filtr Perifix® oraz drenik infuzyjny nie zawierający DEHP. Podaj anestetyk. Umocuj cewnik w miejscu wejścia do skóry, na przykład za pomocą systemu mocowania cewników Perifix®.

Nazwa produktu	Szlif	ø (G) długość (cal)	ø (mm) długość (mm)	Min. zam. (szt.)	Nr kat.
Contiplex® C zestaw	15°	25G x 7 1/2"	0.53 x 190 mm	5	4895000
Contiplex® C zestaw	30°	25G x 7 1/2"	0.53 x 190 mm	5	4898130

W zestawie: Cewnik Contiplex 1,10 x 0,60 x 188mm, łącznik do cewnika, filtr, PinPad –mocowanie filtra, etykieta cewnika, drenik infuzyjny 2,0 x 0,9 x 300 mm


Opis produktu	Min. Zamówienie (szt)	Nr katalogowy
Mocowanie cewnika z opatrunkiem	25	4511200
Opatrunek do mocowania cewnika	25	4511201

Dodatkowe informacje na stronie : www.contiplexc-bbraun.com

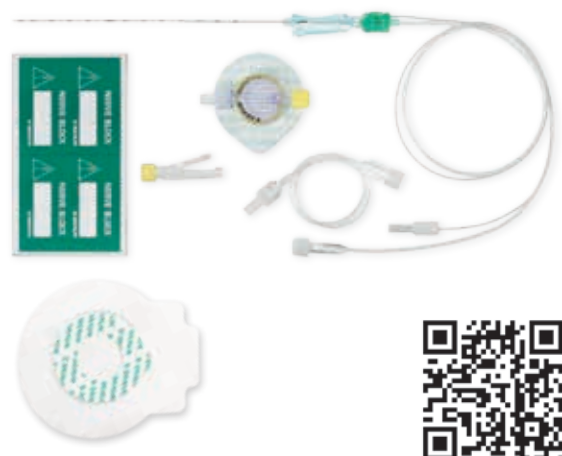

Zestawy do przetoczeń płynów infuzyjnych

Medifix® – infuzyjny system pomiaru Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego (OCŻ)

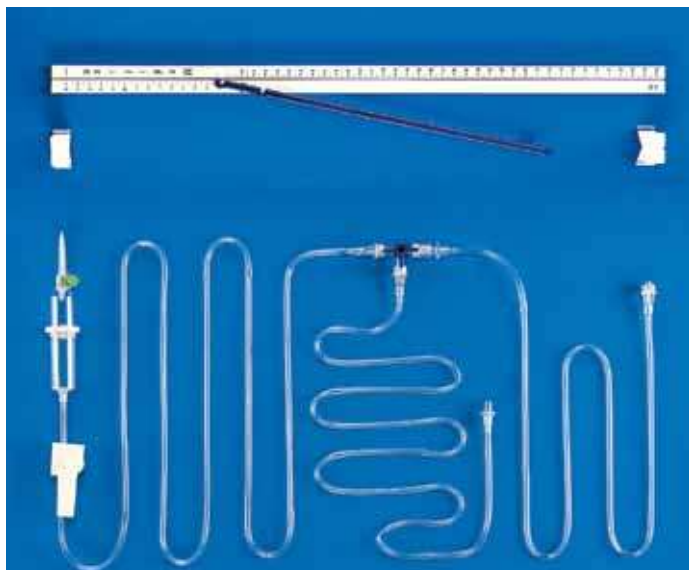

Medifix® skala pomiarowa

- skala od +35 do -15 cm H₂O
- bardzo czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia
- wskaźnik pozycji zero, ruchomy na obie strony skali
- wykonana z odpornego na złamanie plastiku
- wielokrotnego użytku
- z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego

Medifix® zestaw drenów

- wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix® Air lub bez
- Discofix® kranik trójdrożny
- zakończenie lock

Nr katalogowy	Intral Fix Air G		Długość drenu w skali (cm)	Z pętlą do powieszenia	Jedn. handlowa (szt.)
	Dren	Długość drenu (cm)			
4276116	-	-	100	-	50
4276108	-	-	180	+	50
4276620	+	80	100	-	50
4276612	+	145	100	-	50
4276728	+	80	180	-	50
4279913	Medifix® skala pomiarowa				5



Certofix® Highflow

Specjalne rozwiązania dla wielkoobjętościowych infuzji


Kanały o dużej średnicy są stworzone do wymiany płynów o dużych objętościach w krótkich okresach jak również do żyłno-żylnych ostrych dializ.



Quinto

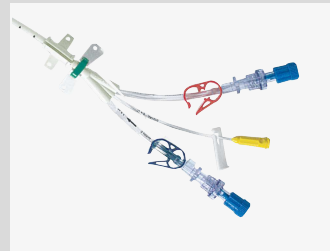

Duo / Trio

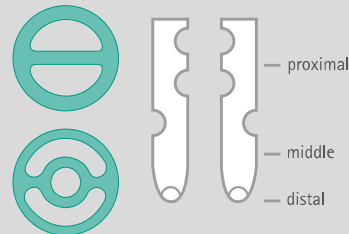

- Poliuretanowy kontrastujący w RTG cewnik z
 - miękką końcówką
 - znacznikami długości
 - elementem mocującym cewnik do skóry
 - przezroczystymi drenikami
 - kolorowymi oznaczeniami poszczególnych kanałów
 - zaciskami ślizgowymi na drenikach
- Akcesoria w zależności od konfiguracji zestawu
 - ruchome drugie skrzydełko mocujące
 - skalpel
 - zastawka bezigłowa Safsite®
 - strzykawka 3-częściowa 5ml luer lock

Korzyści dla użytkownika

- Cewnik 12F mimo dużej średnicy kanałów, zachowuje oczekiwaną sztywność
- Dodatkowe skrzydełko mocujące zapewniają większą stabilizację umocowania cewnika do skóry
- Do zastosowania przy ostrych dializach (dwa kanały proksymalne) oraz do dużych przepływów.
- Dostępny także z nie wypłukiwaną antybakteryjną powierzchnią dla ochrony przed zakażeniami odcewnikowymi – Certofix® protect

Certofix[®] Mono

Rodzaj cewnika	Nr katalogowy ¹⁾	Średnice światła cewnika (G)	Prędkość przepływu (ml/min)*	Długość (cm)	Prowadnica		Rodzaj igły wprowadzającej	Kabelek EKG	Zastawka b/igłowa
					Długość (cm)	Materiał			
Mono S 215	4160185-07	18	D 23	15	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono S 315	4160223-07	16	D 60	15	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono V 315	4160231-07	16	D 60	15	50	Nitinol	Igła V	■	-
Mono S 415	4160509-07	14	D 90	15	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono V 415	4160517-07	14	D 90	15	50	Nitinol	Igła V	■	-
Mono S 220	4160207-07	18	D 18	20	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono V 220	4160215-07	18	D 18	20	50	Nitinol	Igła V	■	-
Mono S 320	4160258-07	16	D 52	20	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono V 320	4160266-07	16	D 52	20	50	Nitinol	Igła V	■	-
Mono S 420	4160304-07	14	D 80	20	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono V 420	4160320-07	14	D 80	20	50	Nitinol	Igła V	■	-
Mono S 330	4160282-07	16	D 40	30	70	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono V 330	4160290-07	16	D 40	30	70	Nitinol	Igła V	■	-
Mono S 430	4160762-07	14	D 75	30	70	Nitinol	Igła Seldingera	■	-
Mono V 430	4160789-07	14	D 75	30	70	Nitinol	Igła V	■	-

* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

¹⁾ Producent cewników CERTOFIX wprowadza zmianę w numerach katalogowych, polegającą na dodaniu do obecnego 7-cyfrowego numeru 2 cyfr: -07. Zmiana numerów następuje sukcesywnie w miarę wyprzedaży produktów z dotychczasowymi numerami katalogowymi. Dlatego na rynku przez pewien czas funkcjonować będą 2 numery katalogowe 7- cyfrowe i 9-cyfrowe. Zmiana numerów katalogowych nie wprowadza zmiany w składzie zestawu ani jego funkcjonalności.

Dodatkowe informacje:

- Jednostka handlowa = 10 szt zestawów Certofix[®] Duo lub Trio
- Wszystkie cewniki wykonane z poliuretanu (PUR)



Certofix® Duo / Certofix® Trio

Rodzaj cewnika	Nr katalogowy ¹	Średnice światła cewnika (G)	Prędkość przepływu (ml/min)*	Długość (cm)	Prowadnica		Rodzaj igły wprowadzającej	Kabelek EKG	Mini skalpel	Zastawka b/igłowa
Duo S 715	4164158-07	16/16	D 60; P 50	15	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	■	Zastawka Safesite®
Duo V 715	4166159-07	16/16	D 60; P 50	15	50	Nitinol	igła V	■	■	Zastawka Safesite®
Duo S 720	4167385-07	16/16	D 55; P 45	20	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	■	Zastawka Safesite®
Duo V 720	4161211-07	16/16	D 55; P 45	20	50	Nitinol	igła V	■	■	Zastawka Safesite®
Duo S 730	4167394-07	16/16	D 52; P 37	30	70	Nitinol	Igła Seldingera	■	■	Zastawka Safesite®
Duo V 730	4161319-07	16/16	D 52; P 37	30	70	Nitinol	igła V	■	■	Zastawka Safesite®

* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

Rodzaj cewnika	Nr katalogowy ¹	Średnice światła cewnika (G)	Prędkość przepływu (ml/min)*	Długość (cm)	Prowadnica		Rodzaj igły wprowadzającej	Kabelek EKG	Mini skalpel	Zastawka b/igłowa
Trio S 715	4161159-07	16/18/18	D 50; M1 28; P 28	15	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	■	Zastawka Safesite®
Trio V 715	4162153-07	16/18/18	D 50; M1 28; P 28	15	50	Nitinol	igła V	■	■	Zastawka Safesite®
Trio S 720	4167408-07	16/18/18	D 46; M1 22; P 22	20	50	Nitinol	Igła Seldingera	■	■	Zastawka Safesite®
Trio V 720	4163214-07	16/18/18	D 46; M1 22; P 22	20	50	Nitinol	igła V	■	■	Zastawka Safesite®
Trio S 730	4163306-07	16/18/18	D 38; M1 18; P 18	30	70	Nitinol	Igła Seldingera	■	■	Zastawka Safesite®
Trio V 730	4163311-07	16/18/18	D 38; M1 18; P 18	30	70	Nitinol	igła V	■	■	Zastawka Safesite®

* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

¹⁾ Producent cewników CERTOFIX wprowadza zmianę w numerach katalogowych, polegającą na dodaniu do obecnego 7-cyfrowego numeru 2 cyfr: -07. Zmiana numerów następuje sukcesywnie w miarę wyprzedaży produktów z dotychczasowymi numerami katalogowymi. Dlatego na rynku przez pewien czas funkcjonować będą 2 numery katalogowe 7- cyfrowe i 9-cyfrowe. Zmiana numerów katalogowych nie wprowadza zmiany w składzie zestawu ani jego funkcjonalności.

Dodatkowe informacje:

- Jednostka handlowa = 10 szt zestawów Certofix® Duo lub Trio
- Wszystkie cewniki wykonane z poliuretanu (PUR)



Rodzaj cewnika	Nr katalogowy ¹	Średnica światła cewnika (G)	Prędkość przepływu (ml/min)*	Długość (cm)	Prowadnica Długość (cm)	Mini Scalpel	Zastawka b/igłowa
Mono V 320 Protect	4160266P-07	16	D 52	20	50	-	-
Mono V 420 Protect	4160320P-07	14	D 80	20	50	-	-
Mono V 330 Protect	4160290P-07	16	D 40	30	70	-	-
Mono V 430 Protect	4160789P-07	14	D 75	30	70	-	-
Duo V 715 Protect	4166159P-07	16/16	D 60; P 50	15	50	■	Zastawka Safesite®
Duo V 720 Protect	4161211P-07	16/16	D 55; P 45	20	50	■	Zastawka Safesite®
Duo V 730 Protect	4161319P-07	16/16	D 52; P 37	30	70	■	Zastawka Safesite®
Duo HF V 720 Protect	4168534P-07	14/18	D 100; P 27	20	50	■	Zastawka Safesite®
Trio V 715 Protect	4162153P-07	16/18/18	D 50; M1 28; P 28	15	50	■	Zastawka Safesite®
Trio V 720 Protect	4163214P-07	16/18/18	D 46; M1 22; P 22	20	50	■	Zastawka Safesite®
Trio V 730 Protect	4163311P-07	16/18/18	D 38; M1 18; P 18	30	70	■	Zastawka Safesite®
Trio HF V 1220 Protect	4160622P-07	16/12/12	D 55; M1 165; P 165	20	50	■	Zastawka Safesite®
Quattro V 815 Protect	4167767P-07	14/18/18/16	D 50; M1 20; M2 20; P 50	15	50	■	Zastawka Safesite®
Quattro V 820 Protect	4167775P-07	14/18/18/16	D 40; M1 15; M2 15; P 40	20	50	■	Zastawka Safesite®
Quattro V 830 Protect	4167783P-07	14/18/18/16	D 35; M1 10; M2 10; P 35	30	70	■	Zastawka Safesite®
Quinto V 1220 Protect	4166868P-07	16/18/18/18/12	D 55; M1 28; M2 28; M3 28; P 185	20	50	■	Zastawka Safesite®

* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

¹⁾ Producent cewników CERTOFIX wprowadza zmianę w numerach katalogowych, polegającą na dodaniu do obecnego 7-cyfrowego numeru 2 cyfr: -07. Zmiana numerów następuje sukcesywnie w miarę wyprzedaży produktów z dotychczasowymi numerami katalogowymi. Dlatego na rynku przez pewien czas funkcjonować będą 2 numery katalogowe 7- cyfrowe i 9-cyfrowe. Zmiana numerów katalogowych nie wprowadza zmiany w składzie zestawu ani jego funkcjonalności.

Podstawowym materiałem cewników Certofix® protect jest poliuretan (PUR). Wszystkie światła, jak również końcówki luer lock i zewnętrzna powierzchnia cewnika posiadają wbudowany długołańcuchowy polimer bazujący na metakrylacie. Materiał cewnika posiada również grupy hydrofilne takie jak glikol polietylenu i antyseptyczny polimer biguanid.

- Cewnik poliuretanowy kontrastujący w RTG
 - z miękką końcówką
 - znacznikami długości
 - motylek mocujący cewnik do skóry
 - przezroczyste dreniki prowadzące do kanałów
 - kolorowe oznaczenia poszczególnych światła
 - zaciski ślizgowe koloru zielonego
- Akcesoria w zależności od konfiguracji zestawu
 - ruchome mocujące skrzydełka cewnik do skóry
 - skalpel
 - zastawka bezigłowa Safsite®

Dodatkowe informacje:

- Jednostka handlowa =10 szt zestawów Certofix® Duo lub Trio
- Wszystkie cewniki wykonane z poliuretanu (PUR)

Certofix® Quattro / Certofix® Quinto


Rodzaj cewnika	Nr katalogowy ¹	Średnice światła cewnika (G)	Prędkość przepływu (ml/min)*	Długość (cm)	Prowadnica Długość (cm)	Rodzaj igły wprowadzającej
Quattro V 815	4167767-07	14/18/18/16	D 50; M1 20; M2 20; P 50	15	50	Igła V
Quattro V 820	4167775-07	14/18/18/16	D 40; M1 15; M2 15; P 40	20	50	Igła V
Quattro V 830	4167783-07	14/18/18/16	D 35; M1 10; M2 10; P 35	30	70	Igła V

* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

Rodzaj cewnika	Nr katalogowy ¹	Średnice światła cewnika (G)	Prędkość przepływu (ml/min)*	Długość (cm)	Prowadnica Długość (cm)	Rodzaj igły wprowadzającej
Quinto V 1215	4166841-07	16/18/18/18/12	D 65; M1 32; M2 32; M3 30; P 225	15	50	Igła V
Quinto S 1220	4166852-07	16/18/18/18/12	D 55; M1 28; M2 28; M3 28; P 185	20	50	Igła Seldingera
Quinto V 1220	4166868-07	16/18/18/18/12	D 55; M1 28; M2 28; M3 28; P 185	20	50	Igła V


* D (distal); M1 (middle1); M2 (middle2); M3 (middle3); P (proximal)

¹⁾ Producent cewników CERTOFIX wprowadza zmianę w numerach katalogowych, polegającą na dodaniu do obecnego 7-cyfrowego numeru 2 cyfr: -07. Zmiana numerów następuje sukcesywnie w miarę wyprzedaży produktów z dotychczasowymi numerami katalogowymi. Dlatego na rynku przez pewien czas funkcjonować będą 2 numery katalogowe 7- cyfrowe i 9-cyfrowe. Zmiana numerów katalogowych nie wprowadza zmiany w składzie zestawu ani jego funkcjonalności.

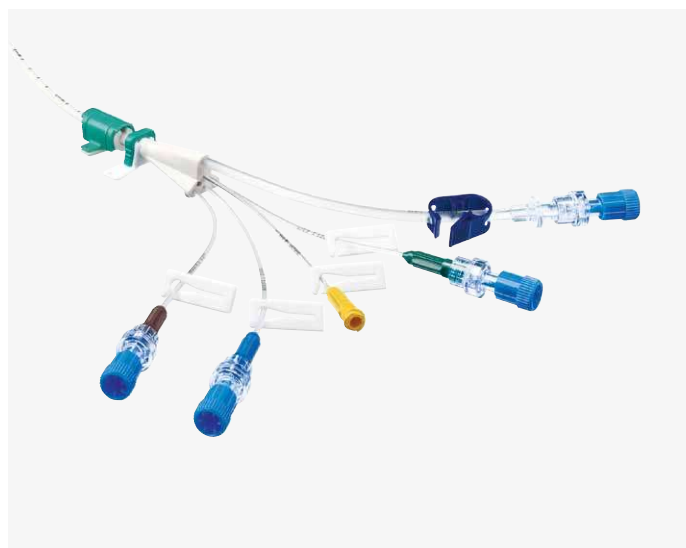

Zestawy do punkcji jamy opłucnej

Pleurofix®

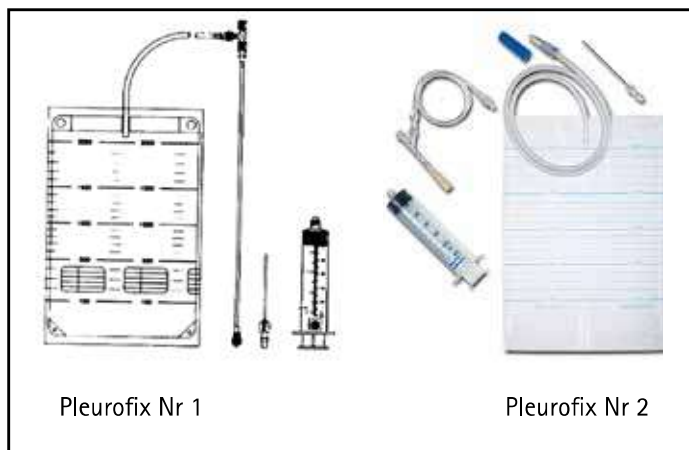

- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem
– średnica 1,8 mm, długość 80 mm
- dren łączący z końcówką lock
- strzykawka trzyczęściowa Omnifix® lock 60 ml jednorazowego użytku
- worek 2,0 l

Nr katalogowy	Nazwa	Opis	Jedn. handlowa (szt.)
4461002	Pleurofix nr 1	z żółtym kranikiem trójdrożnym	25
4461037	Pleurofix nr 2	z zastawką antyrefluksową	25

Zestawy do diagnostycznego płukania otrzewnej

Peritofix®



- trokar punkcyjny Ch. 10
 - z regulowaną głębokością wkłucia
 - składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa
- cewnik 9 Ch / 50 cm wykonany z poliuretanu
 - zamknięty koniec, boczne otwory
 - kolorowe oznakowanie długości
- skalpel do nacięcia skóry

Nr katalogowy	Nazwa	Jednostka handlowa (szt.)
4463005	Peritofix	10



Transofix – krótki kolec przelewowy

- służy do przelewania płynów w bezpieczny sposób
- stosuje się do przelewania płynu z fiolek
- wykorzystywany na sali operacyjnej do bezpiecznego przemycania



Ecoflac Mix – nasadka na butelkę Ecoflac

- nasadka Ecoflac mix umożliwia bezpośrednie przeniesienie leku z fiołki do pojemnika Ecoflac® plus
- umożliwia bezpieczne przygotowanie leku



Ecoflac Connect – nasadka na butelkę Ecoflac

- nasadka Ecoflac Connect umożliwia bezpośrednie przeniesienie leku z fiołki do pojemnika Ecoflac® plus
- umożliwia bezpieczne przygotowanie leku
- połączenie tworzy system zamknięty



Łącznik FDC 1000 – łącznik międzyszyrkawkowy

- umożliwia szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami


Nr katalogowy	Produkt	Jednostka handlowa (szt.)
4090500	Transofix – krótki kolec przelewowy	200
16401	Ecoflac Mix	250
4090550	Ecoflac Connect	50
415080	Łącznik FDC1000	100

Braunüle[®] MT

Braunüle[®] cannula for catheterization
of the vena cava

EAN-Code of the
sales unit

Code-No./REF –
sales unit-pcs.



Braunüle[®] MT

Braunüle[®] MT
Introducer cannula for insertion of Cavafix[®] catheters
and temporary pacemaker electrodes

Plastic cannula
– Made of polypropylene

Grip plates for secure cannula guidance

Lock fitting

Hydrophobic blood stopper

Braunüle[®] MT

Size	G	Inner diameter mm	Outer diameter mm	Length mm		
1	18	1.00	1.50	40	4 022495 008312	4206142 50 units
2	16	1.50	2.00	50	4 022495 008268	4206258 50 units
2	16	1.50	2.00	70	4 022495 008510	4206274 50 units
3	14	1.80	2.35	50	4 022495 008565	4206355 50 units
3	14	1.80	2.35	80	4 022495 008367	4206380 50 units
4	12	2.20	2.70	50	4 022495 008411	4206452 50 units
4	12	2.20	2.70	80	4 022495 008466	4206487 50 units

→
Cava catheter set –
Cavafix[®] Certo with
Braunüle[®] MT,
p. 134 ff.

→
Cava catheter set –
Cavafix[®] MT with
Braunüle[®] MT,
p. 137

JK SURGICAL Sp. z o.o.

PRZEDSTAWICIEL FIRMY

Asortyment ostrzy i rękojeści chirurgicznych

Swann-Morton



Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 3

Ostrza chirurgiczne nr 6, 9, 10, 10A, 11, E/11, 12, 12D, 14, 15, 15A, 15C, 16 mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre są wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty pakowane są pojedynczo. Uchwyt B3, wykonany jest z lekkiej stali nierdzewnej, pakowany indywidualnie w plastikowe etui.




nr 6




nr 13



nr 9

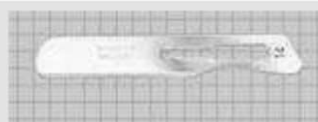

nr 14

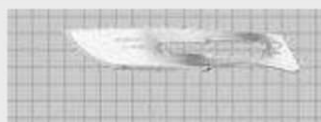

nr 10




nr 15



nr 10A



nr 15A

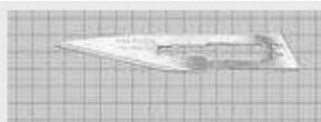

nr 11



nr 15C



nr 11P



nr 15T



nr E/11 Sabre



nr D/15 Sabre



nr E11



nr 16



nr 12



nr 12D

nr 40



nr SG3

Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 4

Ostrza chirurgiczne nr 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 36 mocowane w uchwytych nr 4, 4L oraz 6. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty są pakowane pojedynczo.


Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali węglowej (sterylne lub niesterylne) lub ze stali nierdzewnej (sterylne). Pakowane w pudełkach po 100 sztuk (noże sterylne są pakowane pojedynczo w folię), schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym; noże niesterylne pakowane są w folii hermetycznie po 5 sztuk). Ostrza niesterylne dostępne są również w pudełkach po 100 sztuk, pakowane pojedynczo. Ostrza Sabre E/11 oraz D/15 produkowane są ze stali węglowej, tylko w wersji sterylnej w pudełku po 100 sztuk. Oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu.




nr 18



nr B23 Sabre

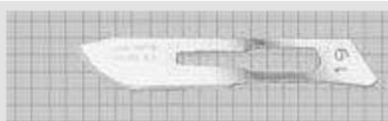

nr 19

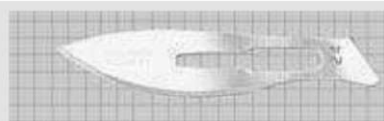


nr 24



nr 20



nr 25

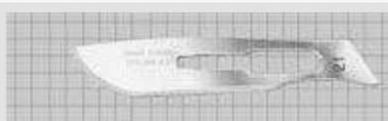

nr 21



nr 25A



nr 22



nr 26



nr 22A



nr 27



nr 23



nr 36

DOCUMENT
CREATED
WITH



PDF
COMBINER

PDF Combiner is a free application that you can use to combine multiple PDF documents into one.

Three simple steps are needed to merge several PDF documents. First, we must add files to the program. This can be done using the Add files button or by dragging files to the list via the Drag and Drop mechanism. Then you need to adjust the order of files if list order is not suitable. The last step is joining files. To do this, click button Combine PDFs.

Main features:

secure PDF merging - everything is done on your computer and documents are not sent anywhere

simplicity - you need to follow three steps to merge documents

possibility to rearrange document - change the order of merged documents and page selection

reliability - application is not modifying a content of merged documents.

Visit the homepage to download the application:

www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

To remove this page from your document, please donate a project.