



Grudziądz, dnia 12.05.2025 r.

ZP-909/25

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/11/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/11/PN/25)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Zwracamy się do Zmawiającego o możliwość złożenia oferty konkurencyjnej cenowo osłony sterylnej na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss KINEVO 900 / Tivato 700, bez chipa ale posiadającej aż 5 pasów do właściwego mocowania na mikroskopie. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 132 x 381cm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 12 zaoferowanie nakłuwaczy pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1500 op ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 jak poniżej.**

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 42 dopuści cewnik do nakłucia tętnicy wprowadzany techniką Seldingera.



Zestaw zawiera:

- 1 igła 20G





- 1 prosty przewodnik,
- 1 rura przedłużająca PU o długości 10 cm z funkcją Autoflush,
- 1 przezroczysty cewnik z polietylenu ze skrzydełkami 20 G o długości 800mm?

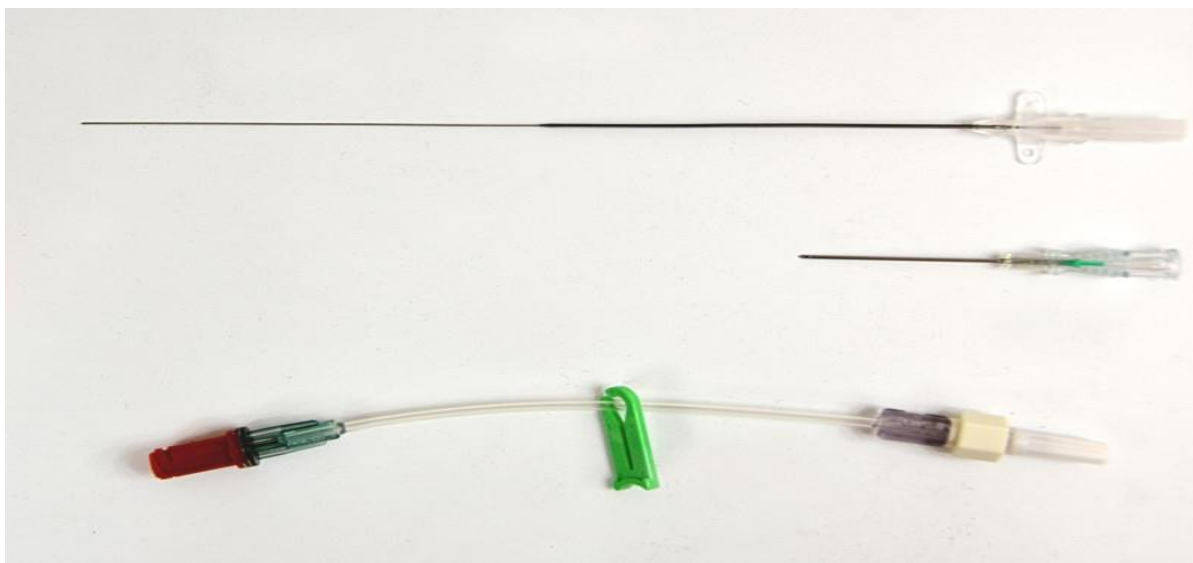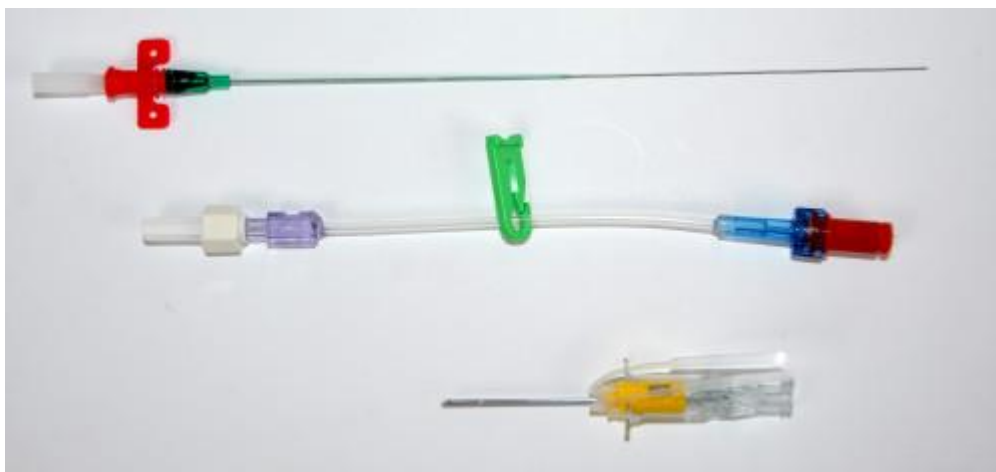

Cewnik tętniczy z PTFE wprowadzany klasyczną techniką Seldingera.

Zawartość zestawu::

- cewnik 20G o długości 800mm i akcesoria/elementy umożliwiające jego wprowadzenie
- igła do nakłuwania,
- prosty, radiocieniujący przewodnik ze stali nierdzewnej z jednym elastycznym końcem.
- linia przedłużająca wyposażona w zacisk i czerwony dwukierunkowy łącznik bezigłowy, zamykający się automatycznie po odłączeniu linii infuzyjnej?





Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 42 jak poniżej.**

Zapytanie nr 4:

Dotyczy zadania nr 7. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7, pozycji 2, igieł do nakłuć lędźwiowych o dł. 38mm ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SWZ w zakresie zadania nr 7 jak poniżej.**

Zapytanie nr 5:

Pakiet 35 poz. 1. Czy zamawiający dopuści worki o zakresie docięcia 13-60-80mm i poj. 580 ml?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 6:

Pakiet 35 poz. 2. Czy zamawiający dopuści worki o zakresie docięcia 13-60-80mm i poj 470 ml?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 7:

Pakiet 35 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ekonomiczną pastę stomijną w opakowaniu 100g, z odpowiednim przeliczeniem gramatury - z liczby oczekiwanych 10 opakowań 60 g wynika, że Zamawiający oczekuje łącznie 600g. Zatem czy oferując pastę w opakowaniu 100g możemy zaoferować 6 szt. pasty?

Odpowiedź:






W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SWZ w zakresie zadania nr 35 jak poniżej.**

Zapytanie nr 8:

Pytanie do zadania 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce aktualnych zapisów SWZ następującego rozwiązania wg opisu:

Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z PEBA kodowany kolorystycznie w rozmiarze 22a/8cm z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi dwa otwory na szew mocujący i zintegrowanym przedłużaczem z przesuwającym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozmiarze 22Ga/4cm, przewodnik 0,021"/35cm o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki przewodnika znajdują się w końcówce igły. Co najmniej dwie wkładki do historii choroby/zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny pakowany papier/folia. Opakowanie handlowe 10 szt.

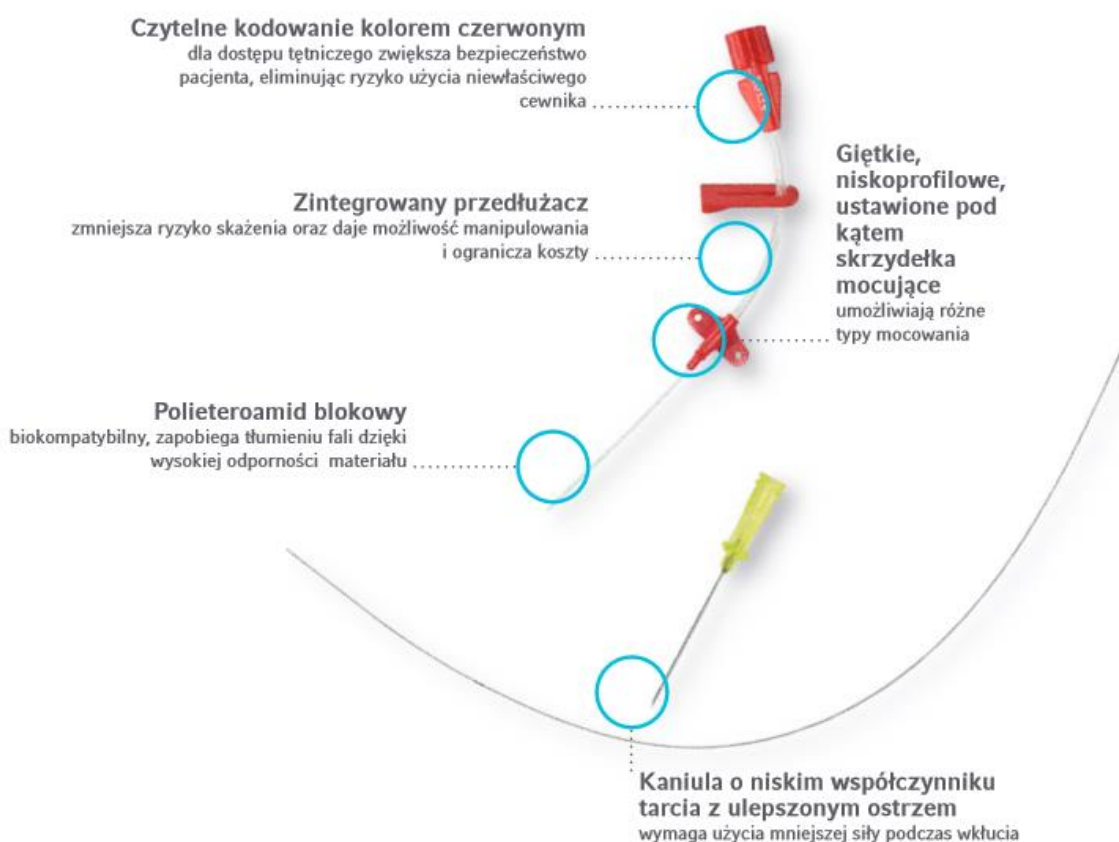



Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 42 jak poniżej.**

Zapytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 35 – worki pakowane po 30 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się poza granicami kraju skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli posiada informację o opakowaniach zbiorczych, tak realizuje zamówienia.

Zapytanie nr 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na wystawienie faktury każdorazowo do zamówienia. Nie mamy możliwości odroczyć wystawienia faktury, która generuje się w godzinach wieczornych w dniu w którym magazyn przystępuje do realizacji zamówienia. Anulowanie wystawienia faktury skutkowałoby anulowaniem zamówienia.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: Z/11/PN/25), w następującym zakresie:

– w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 7, 12, 35, 42 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 7, 12, 35, 42 jak w załączeniu.





Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji
lub
- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.