



Grudziądz, dnia 05.05.2025 r.

ZP-861/25

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy łat naczyniowych dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/18/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy łat naczyniowych dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/18/PN/25**), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3

Dla pozycji 1 oczekuje:

Łaty naczyniowej z dzianiny poliestrowej impregnowanej kolagenem pochodzenia bydlęcego typu 1 po, po obu stronach.

W celu ułatwienia ich prawidłowego pozycjonowania podczas implantacji, łaty naczyniowe są dostarczane z czarną linią pomocniczą.

Łaty dostępne są w dwóch modelach:

Kształt prostokątny

lub


Anatomiczny kształt ze stożkowymi, wstępnie przyciętymi krawędziami

Grubość ścianki $\leq 0,5$ mm

Opatentowana technologia impregnacji: Kolagen CXE, bez formaldehydu i glutaraldehydu

Sila retencji szwów $\geq 8N$

Rozmiar 10mm x 75 mm?

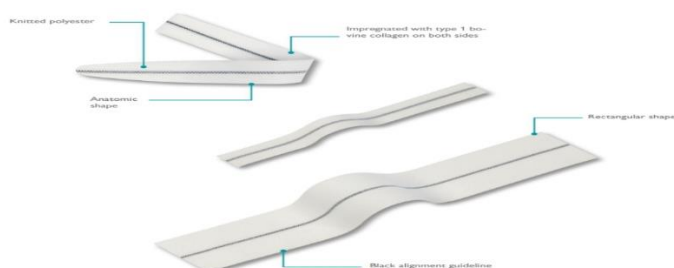



Dla pozycji 2 oczekuje

Łaty naczyniowej z dzianiny poliestrowej impregnowanej kolagenem pochodzenia bydlęcego typu 1 po, po obu stronach.

W celu ułatwienia ich prawidłowego pozycjonowania podczas implantacji, łaty naczyniowe są dostarczane z czarną linią pomocniczą.


Łata w kształcie prostokątnym

Grubość ścianki $\leq 0,5$ mm

Opatentowana technologia impregnacji: Kolagen CXE, bez formaldehydu i glutaraldehydu

Siła retencji szwów $\geq 8N$

Rozmiar 10mm x 75 mm?

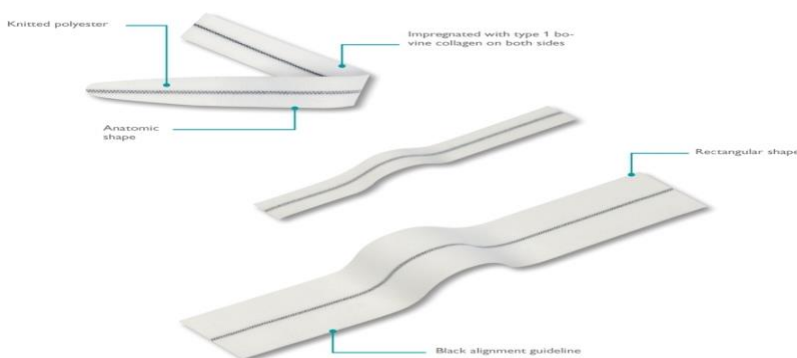

Dla pozycji 2

Rozmiar 14mm x 75 mm

Odpowiedź

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytania informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 3 i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3

Dla pozycji 1 oczekuje:

Łaty naczyniowej z dzianiny poliestrowej impregnowanej kolagenem pochodzenia bydlęcego typu 1 po, po obu stronach.

W celu ułatwienia ich prawidłowego pozycjonowania podczas implantacji, łaty naczyniowe są dostarczane z czarną linią pomocniczą.





Łaty dostępne są w dwóch modelach:

Kształt prostokątny

lub


Anatomiczny kształt ze stożkowymi, wstępnie przyciętymi krawędziami

Grubość ścianki $\leq 0,5$ mm

Opatentowana technologia impregnacji: Kolagen CXE, bez formaldehydu i glutaraldehydu

Sila retencji szwów $\geq 8N$

Rozmiar 10mm x 75 mm?

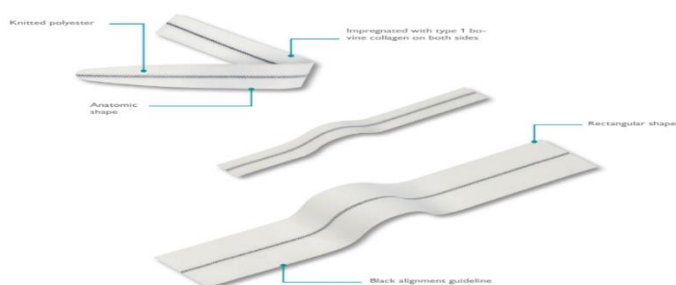

Dla pozycji 2 oczekuje

Łaty naczyniowej z dzianiny poliestrowej impregnowanej kolagenem pochodzenia bydlęcego typu 1 po, po obu stronach.

W celu ułatwienia ich prawidłowego pozycjonowania podczas implantacji, łaty naczyniowe są dostarczane z czarną linią pomocniczą.


Łata w kształcie prostokątnym

Grubość ścianki $\leq 0,5$ mm

Opatentowana technologia impregnacji: Kolagen CXE, bez formaldehydu i glutaraldehydu

Sila retencji szwów $\geq 8N$

Rozmiar 14mm x 75 mm

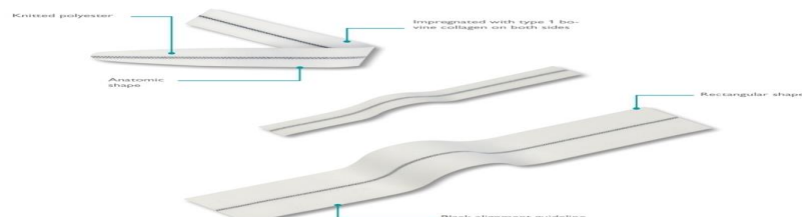



Odpowiedź

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytania informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 3 i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3

Dla pozycji 1 i 2 oczekuje:

Łaty naczyniowej o sile retencji szwów $\geq 8N$?

Odpowiedź

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytania informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 3 i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3

Dla pozycji 1 i 2 oczekuje:

Łaty naczyniowej o przepuszczalności wody poniżej 10 ml/cm²/min pod ciśnieniem 120 mmHg?

Odpowiedź

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytania informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 3 i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy łat naczyniowych dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: Z/18/PN/25), **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 3 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 3 po modyfikacji jak w załączeniu.





Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

