



Nr sprawy: **DEZP.261.10.2025**

Sosnowiec, dnia 23.04.2025r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Pn: „Dostawa implantów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Kardiologii Ogólnej oraz dzierżawa aparatu wraz z dostawą płynów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 3 – Formularzu asortymentowo – cenowym (opis przedmiotu zamówienia), wszelkich dopuszczeń Zamawiającego w danych częściach oraz pozycjach, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1

Pakiet 24 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści kabel połączeniowy do elektrody ablacyjnej o długości powyżej 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 25 pkt 9

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dzierżawy sesyjnej czy dzierżawy miesięcznej generatora do elektroporacji? Obecne zapisy formularza cenowego (poz. 9) są niejednoznaczne: kol.

"Nazwa asortymentu" (Dzierżawa sesyjna generatora kompatybilnego z elektrodą z pkt.1) wskazuje na dzierżawę sesyjną, natomiast pozostałe kolumny, w tym "okres trwania" oraz "cena netto" na dzierżawę na 36 miesięcy.

W konsekwencji, jeśli Zamawiający oczekuje dzierżawy sesyjnej - prosimy o wskazanie liczby sesji oraz odpowiednią zmianę nagłówek kolumn.

Jesli zaś Zamawiający oczekuje dzierżawy na okres 36 miesięcy - prosimy o usunięcie zapisu "sesyjna" w kolumnie " i zmianę na "Dzierżawa miesięczna generatora kompatybilnego z elektrodą z pkt.1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 3 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) – Formularz asortymentowo – cenowy oraz załącznik nr 8a do SWZ (wzór umowy)

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik 8 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:





„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę oraz modyfikuje załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 2

Wnosimy o dokonanie zmiany § 9 ust. 3 (zał. 8 do SWZ), § 8 ust. 3 (zał. 8a do SWZ) projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w w nim maksymalnej wysokości kar umownych z 50% do 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Wnosimy o dokonanie zmiany § 9 ust. 3 (zał. 8b do SWZ) projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w w nim maksymalnej wysokości kar umownych z 70% do 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 70% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę oraz modyfikuje załącznik 8b do SWZ.

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1


Pakiet 30: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów hemodynamicznych nieznacznie różniący się od wymaganego:

1. Serweta angiograficzna w rozmiarze 370X240 cm z przeźroczystą, foliową wstawką z obu stron na całą długość zabezpieczająca panel sterowania stołu; z 4 otworami przyklepnymi do angiografii :2 owalne otwory z





dostępem do tętnic promieniowych w rozmiarze 7x12 cm (dłuższy wymiar równoległy do krawędzi bocznej serwety w odległości 86,75 cm od górnej krawędzi serwety oraz dwa otwory z dostępem do pachwin o średnicy 12 cm w odległości 96,75 cm od górnej krawędzi serwety. Otwory otoczone taśmą samoprzylepną i warstwą chłonną. Serweta w całości wykonana z laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen+polietylen, polipropylen), nieprzemakalnego. W środkowej części serwety warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 120x155 cm w odległości 60 cm od górnej krawędzi serwety. Gramatura w części podstawowej min. 55g/m². Gramatura w części chłonnej 60g/m² (łata chłonna). Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 115g/m². Wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro obszar krytyczny min. 286 kPa, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 720 cm H₂O- 1 szt.

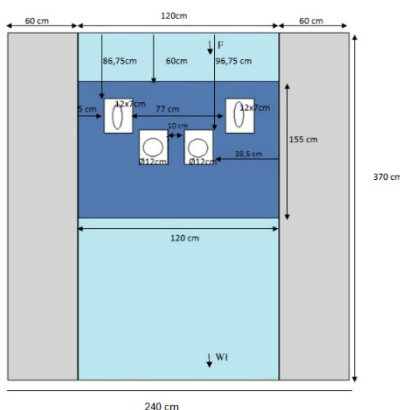

2. Fartuch chirurgiczny XL wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m². Miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzep. Odporność na przenikanie cieczy min. 37cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 132/138 – 1 szt.
3. Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m². Fartuch z wstawkami chłonnymi wykonanymi z laminatu PE/PP o gramaturze 40g/m², miękkimi, poliestrowymi mankietami nie powodującymi nacisku na skórę, z szwem podwójnym ultradźwiękowym i szerokimi rękawami zapewniającymi swobodę ruchów. Zapinanie na szyi, na rzep. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 129 kPa – 1 szt
4. Serwetki celulozowe do osuszania rak w rozmiarze 40x30 cm – 4 sztuki
5. Pojemnik plastikowy okrągły o pojemności 500 ml, niebieski, podziałka co 100 ml - umożliwia identyfikację objętości płynów – 1 sztuka
6. Pojemnik plastikowy okrągły o pojemności 250 ml, niebieski, podziałka co 50 ml - umożliwia identyfikację objętości płynów – 1 sztuka
7. Skalpel jednorazowy nr 11 z rączką, z zabezpieczonym ostrzem- 1 szt
8. Szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego plastikowa rączka - 1 sztuka
9. Kompresy gazowe 17nitkowe 8warstwowe 7,5x7,5 cm – 50 sztuk
10. Osłona na sprzęt, foliowa, okrągła typu beret 162x81 cm z gumką – 1 sztuka
11. Osłona na sprzęt, foliowa, okrągła typu beret 112x56 cm z gumką – 1 sztuka
12. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 20ML Luer Lock – 2 sztuki
13. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 10ML Luer Lock – 1 sztuka
14. Serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 190X150CM służąca za owinięcie zestawu – 1 sztuka.
Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety typu TAG z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie transportowe. Opis zestawu w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 31

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę PE w formie beretu z gumką o gramaturze 41 µm, Średnica w stanie rozciągniętym: 162cm, Średnica w stanie swobodnym: 55cm, Rozmiar (cm)x(cm): 162cmx81cm ?





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 31

Poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety o rozmiarze 50x60 cm?. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet 31

Poz. 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę foliową na przewody o rozmiarze 15x250 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. "Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 8 ust. 1 pkt 1)?"

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1

(dot. zał. 8 do SWZ)

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 Ust. 1, 2, 3, 7:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1. w wysokości **0,5%** wynagrodzenia umownego brutto **należnego za niedostarczony/reklamowany przedmiot Umowy** – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 4 oraz § 8 ust. 2 i 4,
2. w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości **0,5%** maksymalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.





7. Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji Umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości **5% niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto danej części zamówienia, określonego w § 6 ust. 3 Umowy, w przypadkach gdy (...)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

(dot. zał. 8 do SWZ)

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1

Część 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie próbek w wersji niesterylnej?


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Część 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną do angiografii o wymiarach 230x320cm z dwoma otworami przylepnymi udowymi o śr. 8,5 cm oraz dwoma otworami przylepnymi promieniowymi 12x15 cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety, wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 86 g/m², o odporności na rozerwanie na sucho 186,3kPa w strefie krytycznej oraz 109,6 kPa w strefie mniej krytycznej, na mokro w strefie krytycznej 94,5kPa, odporności na przenikanie cieczy 505,6cm H₂O?

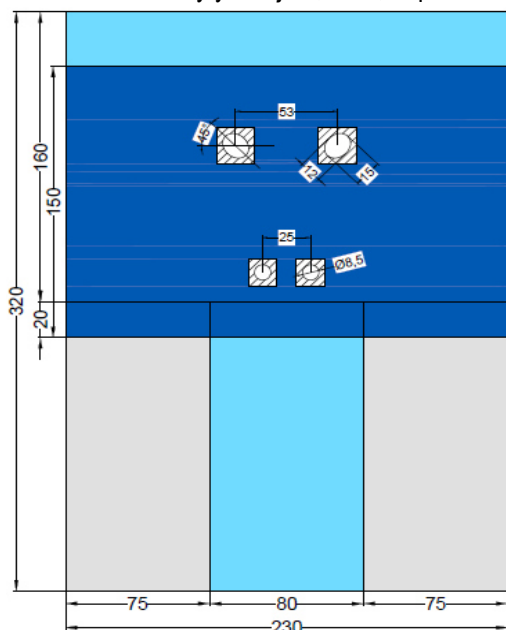



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami celulozowymi w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK, wewnątrz opakowania 4 odklejane etykiety typu TAG z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem z włókniny zamiast w papier krepowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pytanie nr 7

Część 31, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki chłonne wykonane z włókniny spunlace o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część 31, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część 31, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylny pojemnik z zakrętką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 : „Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do doprężeń i do naczyń o krętym przebiegu” dopuści cewnik rapid exchange bez OTW oraz balon wysokociśnieniowy o crossing profil dla balonu 3,0mm- 0,024 " Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

ZESTAW NR 7

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu serwety do angiografii w **Części 30**. Czy Zamawiający wymaga aby serweta miała rozmiar 240x370cm z panelami foliowymi po obu stronach w rozmiarze 70cm, a warstwa wysokochłonna miała rozmiar min. 97x160cm (**160cm na szerokość serwety**), tym samym warstwa chłonna będzie nachodzić na panele foliowe. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 31, Pozycja 1** fartuchów chirurgicznych pakowanych indywidualnie ale bez dodatkowych ręczników i owinięcia w papier krepowy. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza dla pozycji 1, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZESTAW NR 8

Pytanie nr 1

Dotyczy: Część nr 18

Zwracam się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych. Oferowane produkty występują w dwóch rozmiarach, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania. Dodatkowo niewielka ilość w pakiecie, oraz wysoki koszt produktu naraża Wykonawcę na straty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawy sukcesywne oraz modyfikuje SWZ i załączniki nr 1,3 do SWZ.

ZESTAW NR 9

Pytanie nr 1

W związku z opisem technicznym zestawu kompatybilnego z kablami z łączem typu „RJ” poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących wymaganych połączeń.

Czy istnieje możliwość przesłania przez Państwa zdjęć połączenia kabla z monitorem – zarówno po stronie kabla, jak i po stronie monitora – dla angiografów:

Canon model INFX-8000C (2 szt.),

INNOVA IGS 520 (2 szt.)?

Fotografie złączy pozwolą nam na jednoznaczną weryfikację kompatybilności oferowanych kabli i zapewnią spełnienie Państwa oczekiwań technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje nazwę INNOVA IGS 520 na SIEMENS ARTIS Icono w części nr 20 – Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo- cenowy oraz udostępnia zdjęcia w Załączniku nr 1 do odpowiedzi.

ZESTAW NR 10

Pytanie nr 1

do Pakietu nr 5:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 5 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracienką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe





oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń.

Dane techniczne:

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm

Bardzo dobry dostęp do bocznicy - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm.

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu

Materiał – stop Co Cr

Grubość rozpórki – 68 µm

Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna

Polimer – biostabilny polimer akrylowy

Pokrycie stentu - abluminalne

Materiał balonu – nylon 12

Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube

Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu

Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm

Profil wejścia – 0,016"

Profil przejścia – 0,023"

Skrót perspektywiczny - $\leq 2,0\%$

Siła promieniowa - $\geq 0,17\text{N/mm}^2$

Odrzut (recoil) – 4,0%

Lek: sirolimus (rapamycyna)

Dawka leku: 0,90 µm/mm²

Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów

Ciśnienie RBP – 17 barów

Zgodny cewnik prowadzący – 5F

Zgodny przewódnik – max 0,14"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

do Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 7 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracienką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń.

Dane techniczne:

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm

Bardzo dobry dostęp do bocznicy - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm.

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu

Materiał – stop Co Cr

Grubość rozpórki – 68 µm

Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna

Polimer – biostabilny polimer akrylowy

Pokrycie stentu - abluminalne





Materiał balonu – nylon 12
Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube
Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu
Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm
Profil wejścia – 0,016”
Profil przejścia – 0,023”
Skrót perspektywiczny - $\leq 2,0\%$
Siła promieniowa - $\geq 0,17\text{N/mm}^2$
Odrzut (recoil) – 4,0%
Lek: sirolimus (rapamycyna)
Dawka leku: $0,90\text{ }\mu\text{m/mm}^2$
Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów
Ciśnienie RBP – 17 barów
Zgodny cewnik prowadzący – 5F
Zgodny przewodnik – max 0,14”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

ZESTAW NR 11

Pytanie nr 1

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 8b do SWZ) możemy zmienić par. 4 ust. 1 pkt. 2 na: „do przeprowadzenia jednego szkolenia kierowanego do personelu oraz pracowników Pracowni Hemodynamiki Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia, konserwacji oraz wykonania badań”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 8b do SWZ), możemy zmienić par. 7 ust. 6 na: „Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy”.

Obecne brzmienie jest bardzo korzystne dla Odbiorcy, ponieważ pozwala mu na wypełnienie obowiązku zapłaty poprzez samo zainicjowanie przelewu bankowego, bez upewnienia się, że środki faktycznie wpłyną na rachunek Dostawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 8b do SWZ), możemy zmienić par. 9 ust. 1 pkt 4) w następujący sposób: „w wysokości 0,01% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – za naruszenie terminów realizacji obowiązków gwarancyjnych określonych w § 8”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 8b do SWZ), możemy zmienić par. 9 ust. 5 w następujący sposób: „Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, wyłącznie po upływie terminu wymagalności kary umownej oraz po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o zamiarze dokonania potrącenia z co najmniej trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, wraz z jego uzasadnieniem”?

Obecne brzmienie tego paragrafu jest skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy, gdyż oznacza, że Zamawiający może potrącić karę umowną, nawet jeśli jeszcze nie nadszedł termin jej zapłaty (czyli kara nie jest jeszcze wymagalna), a Zamawiający sam ocenia, czy powstało uprawnienie do żądania kary.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 8b do SWZ), możemy zmienić par. 9 ust. 9 poprzez dodanie na końcu fragmentu: „Zamawiający obciąża Wykonawcę różnicą wartości zrealizowanego zamówienia u innego kontrahenta, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania zamówienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu. Różnica, co do której zapłaty zobowiązany jest Zamawiający, wynosi maksymalnie 10%”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 8b do SWZ) w par. 9 ust. 3 możemy zmniejszyć łączną wysokość kar umownych, wynikających z niniejszej Umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 12

Pytanie nr 1

dotyczy Załącznik nr 8a do SWZ Umowa dostawy § 8 ust 1 pkt. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar do wartości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 Umowy obliczonego od wartości zamówienia lub zamówienia częściowego – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminów, o których mowa w § 3 ust. 9 oraz § 7 ust. 4?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

dot. Załącznik nr 8a do SWZ § 8 ust. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do wartości 20 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Agnieszka Kozak

