



Grudziądz, dnia 09.05.2025 r.

ZP-887/25

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy obłożeń chirurgicznych na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/22/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy obłożeń chirurgicznych na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/22/PN/25**), wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zadanie 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie z 2 naklejkami do dokumentacji medycznej w formie opisowej?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 1 jak poniżej.

Zapytanie nr 2

Zadanie 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 1 jak poniżej.

Zapytanie nr 3

Zadanie 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy 10cmx10cm z wycięciem Y?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 4

Zadanie 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie z 2 naklejkami do dokumentacji medycznej ze składem w formie opisowej?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 5

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym ze składem w formie opisowej?

1	Podkład chłonny 60cm x 90cm
3	Serweta chłonna 60cm x 80cm z włókniny typu Spunlace 40g/m ²
1	Kocyk flanelowy 160cm x 75cm o gramaturze 165g/m ²
1	Serweta chirurgiczna 80cm x 90cm (niebieski SMS)
1	Czapeczka dla noworodka 165g/m ² roz.38
1	Miarka centymetrowa papierowa 1m

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 4 jak poniżej.

Zapytanie nr 6

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².





- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 7

Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami.

Zapytanie nr 8

Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m².





- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420% poparta badaniami z akredytowanego laboratorium.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 9

Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m². Chłonność serwetki: 527%?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 10

Zadanie 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu foli wykonanej z surowca pochodzącego z recyklingu?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.


Zapytanie nr 11

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²:

- 1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 8 cm oraz kroczyz o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezłateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora, lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości.
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma typu rzep 2x22cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

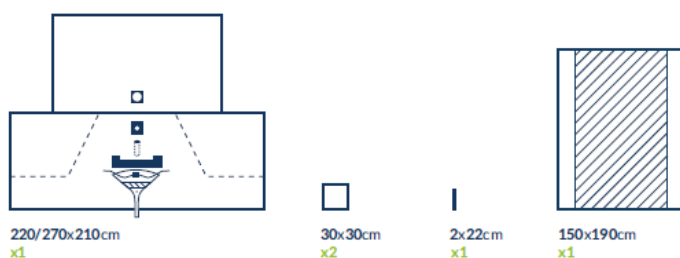

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 12

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie, ze składem w formie opisowej?

• 1	• Serweta z włókniny dwuwarstwowej 114 x 150 zintegrowana z torbą na płyny o gramaturze 60g/m ²
• 1	• Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 3 warstwowa
• 1	• Serweta chłonna 60cm x 80cm



• 6	• Serweta chłonna dla noworodka 25cm x 25cm z włókniny typu Spunlace o chłonności 878%
• 1	• Podkład chłonny 60cm x 60cm (chłonność 995g)
• 1	• Podkład chłonny 60cm x 90cm (chłonność 1326g)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 13

Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Serwety wyposażone w taśmę lepłą o szerokości 2,5cm.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 14

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną,





zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w sztywnik do formowania serwety na głowie

- *1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 15

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści osobno pakowany ręcznik chłonny?.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 16

Zadanie 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

<i>Ilość [szt.]</i>	<i>Nazwa</i>
1	Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm
1	Serweta na stół Mayo 80cm x 140cm wzmocniona, czerwona
1	Serweta do CC 200/260cm x 310cm wzmocniona otwór z folią 30cm x 30cm i wycięciem w kształcie gruszki 16cm x 18cm, torba na płyny 80cm x 80cm
1	Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa
1	Serweta chłonna 75cm x 80cm
2	Fartuch chirurgiczny STANDARD PLUS rozm. L z wstawkami nieprzemakalnymi



1	<i>Fartuch chirurgiczny STANDARD PLUS rozm. XL z wstawkami nieprzemakalnymi</i>
1	<i>Cewnik Nelaton CH10 dł.400mm</i>
1	<i>Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)</i>
1	<i>Końcówka do odsysania pola operacyjnego, bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH21, 4 otwory boczne)</i>
80	<i>Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG</i>
10	<i>Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką</i>
1	<i>Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 10cm x 20cm</i>
3	<i>Serwetka chłonna 30cm x 30cm</i>

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 13 jak poniżej.

Zapytanie nr 17

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

<i>Ilość [szt.]</i>	<i>Nazwa</i>
6	<i>Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm</i>
1	<i>Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm</i>
1	<i>Chwytnik plastikowy (Kocher, Pean) 14cm</i>
1	<i>Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm</i>





1	Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
1	Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock
1	Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa
1	Igła iniekcyjna (0,8 x 40 / 21G x 1½"), ciemnozielona
1	Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 6cm
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 15 jak poniżej.

Zapytanie nr 18

Zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Ilość [szt.]	Nazwa
1	Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 10cm
1	Ostrze do ściągania szwów długie 11cm
1	Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
2	Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
5	Kompres z włókniny 40G 4W 10cm x 10cm
5	Kompres z włókniny 40G 4W 7,5cm x 7,5cm
3	Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm





1	<i>Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny, rozm. 10cm x 15cm</i>
1	<i>Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L</i>
1	<i>Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką</i>
1	<i>Chwytnik plastikowy okienkowy (Korcang) 18cm niebieski</i>
1	<i>Serweta chirurgiczna 95cm x 120cm (niebieski SMS)</i>

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 16 jak poniżej.

Zapytanie nr 19

Zadanie 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

<i>Ilość [szt.]</i>	<i>Nazwa</i>
1	<i>Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm (niebieski SMS)</i>
1	<i>Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, 2-częściowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym o śr. 7cm [KOMPLET]</i>
2	<i>Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką</i>
15	<i>Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG</i>
1	<i>Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul, samoprzylepny, rozm. 5,1cm x 7,6cm</i>
1	<i>Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer</i>
1	<i>Igła iniekcyjna (0,8 x 40 / 21G x 1½"), ciemnozielona</i>
1	<i>Ostrze chirurgiczne z trzonkiem i osłonką nr 10</i>





1	Kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 18cm
1	Kleszczyki HALSTEAD MOSQUITO zakrzywione metalowe 12,5cm
1	Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
1	Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14cm
1	Nożyczki ostre/tępe metalowe 15cm
1	Chwytnik plastikowy okienkowy (Korcang) 18cm niebieski

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 16 jak poniżej.

Zapytanie nr 20

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,80 x 0,50mm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że pytanie zostało źle sformułowane, gdyż dotyczy zadania, w którym znajdują się dwa rodzaje igieł.

Zapytanie nr 21

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści kieszonkę na ssak 50cm x 60cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 17 jak poniżej.

Zapytanie nr 22

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę do zabiegów bariatrycznych 300/200 x 360cm, 2-warstwową ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w



okolicy jamy brzusznej 45cm x 55cm wypełnionym folią chirurgiczną, posiada 2 dwukomorowe kieszenie na narzędzia i zintegrowany uchwyt do przewodów i drenów?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 17 jak poniżej.

Zapytanie nr 23

Zadanie 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Ilość [szt.]	Nazwa
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
1	Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm
5	Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
4	Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
1	Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa
1	Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer
1	Chwytnak plastikowy (Kocher, Pean) 14cm
1	Pęseta plastikowa 13cm niebieska
1	Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
2	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe rozm. M
	Doklejone do zestawu
1	Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml
2	Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml

Odpowiedź:



W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 18 jak poniżej.

Zapytanie nr 24

Zadanie 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

<i>Ilość [szt.]</i>	<i>Nazwa</i>
2	<i>Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. M</i>
1	<i>Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa</i>
1	<i>Chwytnak plastikowy (Kocher, Pean) 14cm</i>
5	<i>Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm</i>
4	<i>Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 15cm x 15cm</i>
1	<i>Pęseta plastikowa 13cm niebieska</i>
1	<i>Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm</i>
1	<i>Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm</i>
	<i>Doklejone do zestawu</i>
1	<i>Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml</i>
1	<i>Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml</i>

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 18 jak poniżej.

Zapytanie nr 25

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę 230cm x 260cm z wycięciem U 20cm x 100cm z warstwą chłonną 75cm x 140cm?





Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 19 jak poniżej.

Zapytanie nr 26

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 240cm x 150cm z warstwą chłonną 25cm x 60cm z przylepcem o długości 80cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 27

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę 180cm x 150cm bez przylepca?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 28

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 120cm x 35cm składaną?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 19 jak poniżej.

Zapytanie nr 29

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści serwetkę do rąk 30cm x 30cm?





Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 19 jak poniżej.

Zapytanie nr 30

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną 10cm x 50cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 19 jak poniżej.

Zapytanie nr 31

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści folię z laminatu PP+ PE, odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O o chłonności ponad 900%?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 32

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK, ze składem w formie opisowej w środku opakowania w widocznym miejscu?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 19 jak poniżej.

Zapytanie nr 33

Zadanie 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?





Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- *1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm*
- *1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm*
- *1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.*

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści zestaw opisany w zapytaniu wystosowanym przez firmę. Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

Zapytanie nr 34

Zadanie 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- *1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym*
- *1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm*





- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 35

Zadanie 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie





wzmocnionej 87 g/m². Oslona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 23 jak poniżej.

Zapytanie nr 36

Zadanie 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 42 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości nie mniejszej niż 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Stopień 9 repelencji. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym 2,959 IB. Rozmiar: M-długość 120cm, L-długość 130cm, XL-długość 150cm, XXL-długość 170cm. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 37

Zadanie 26, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od oznaczenia HP?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 38

Zadanie 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości nie mniejszej niż 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Stopień 9 repelencji. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym 2,959 IB. Rozmiar: M-długość 120cm, L-długość 130cm, XL-długość 150cm, XXL-długość 170cm. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 39

Zadanie 28 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g $\pm$ 5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt.

Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie.?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 28 jak poniżej.

Zapytanie nr 40

Zadanie 28 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 28 jak poniżej.

Zapytanie nr 41

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji ginekologicznej o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy kroczka o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 42

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści mankiet z dzianiny 7,5cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 29 jak poniżej.

Zapytanie nr 43

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 29 jak poniżej.

Zapytanie nr 44

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści folię z laminatu PP+ PE, odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O o chłonności ponad 900%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści zestaw opisany w zapytaniu wystosowanym przez firmę. Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

Zapytanie nr 45

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK, ze składem w środku opakowania w widocznym miejscu formie opisowej?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 29 jak poniżej.

Zapytanie nr 46

Zadanie 33 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ± 5 g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt.

Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?





Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 47

Zadanie 33 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 48

Zadanie 33 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny oddychający w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 50 cm x 80 cm $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 8,64 g, dwóch warstw celulozy 11,024 g, pulpy celulozowej 42,26 g z superabsorbentem SAP 15 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 28 g. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Opakowanie 10 szt. Chłonność: 1925 g. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 49

Zadanie 33 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 50

Zadanie 33 pozycja 3





Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny oddychający w rozmiarze 60 x 60 cm z wkładem chłonnym 50 cm x 54 cm $\pm$ 2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 5,75 g, dwóch warstw celulozy 7,44 g, pulpy celulozowej 31,08 z superabsorbentem SAP 11 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 18,72 g. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Opakowanie 15 szt. Chłonność: 1431,5 g. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 51

Zadanie 33 pozycja 3,4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 52

Zadanie 33 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cm x 54cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 5,06 g, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP 25,54 g (pulpa) + 3 g (SAP), niebieskiej folii PE 5,28 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 923,4 g.

Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 53

Zadanie 36 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w włókniny SMS 90cm x 100cm stanowiącą owinięcie zestawu?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 36 jak poniżej.

Zapytanie nr 54

Zadanie 36 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe przewiązanie papierową banderolą?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 36 jak poniżej.

Zapytanie nr 55

Zadanie 36 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w włókniny SMS 90cm x 100cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 36 jak poniżej.

Zapytanie nr 56

Zadanie 36 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki 150cm x 190cm ze wzmocnieniem 65cm x 190cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 36 jak poniżej.

Zapytanie nr 57

Zadanie 36 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 140cm x 80cm ze wzmocnieniem z włókniny (wiskoza+poliester) o wymiarach 60cm x 140cm i łącznej gramaturze serwety 87g/m²?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 58

Zadanie 36 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozm. min. 175 x 240cm z otworem o śr. 7cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 36 jak poniżej.

Zapytanie nr 59

Zadanie 36 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 157cm w rozmiarze XXL (zamiast XL)?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 60

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 140cm x 80cm ze wzmocnieniem z włókny (wiskoza+poliester) o wymiarach 60cm x 140cm i łącznej gramaturze serwety 87g/m²?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 61

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki 150cm x 190cm ze wzmocnieniem 65cm x 190cm?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 62

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U, 2-warstwowe, 150cm x 250cm, rozmiar wycięcia 7cm x 70cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 63

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 157cm w rozmiarze XXL (zamiast XL)?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 64

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozm. 30cm x 30cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 36 jak poniżej.

Zapytanie nr 65

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wskazane elementy dodatkowo owinięte w serwetę zamiast w papierowym opakowaniu?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 66

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia w rozm. 30cm x 40cm dwukomorową?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 67

Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną 10cm x 50cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ dla zadania nr 36 jak poniżej.

Zapytanie nr 68

Zadanie 37 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 69

Zadanie 37 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź:





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 70

Zadanie 37 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w SWZ została określona maksymalna wielkość opakowania zbiorczego, tj. opakowanie a'50 sztuk.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy obłożów chirurgicznych na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/22/PN/25), **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 1, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 36 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 1, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 36 po modyfikacji jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji
- lub**
- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

