



Grudziądz, dnia 12.05.2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu jednorazowego dla Oddziału Kardiologii na okres 36 miesięcy (znak sprawy: Z/19/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu jednorazowego dla Oddziału Kardiologii na okres 36 miesięcy (znak sprawy: Z/19/PN/25)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie 1:

Zadanie 12 – Hemofiltr

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 hemofiltr o powierzchni membrany 0,8 m2 przy wypełnieniu 50 ml i max TMP 80 kPa, materiał błony: polieterosulfon?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

Zapytanie 2:

Zadanie 12 – Hemofiltr

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 hemokoncentrator o powierzchni membrany 1,4 m2 przy wypełnieniu priming 85 ml i max TMP 80 kPa, materiał błony: polieterosulfon?

Odpowiedź:


W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

Zapytanie 3:

Zadanie 12 – Hemofiltr

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 i poz.2 hemokoncentraty z zestawem drenów zgodnie z poniższym schematem:



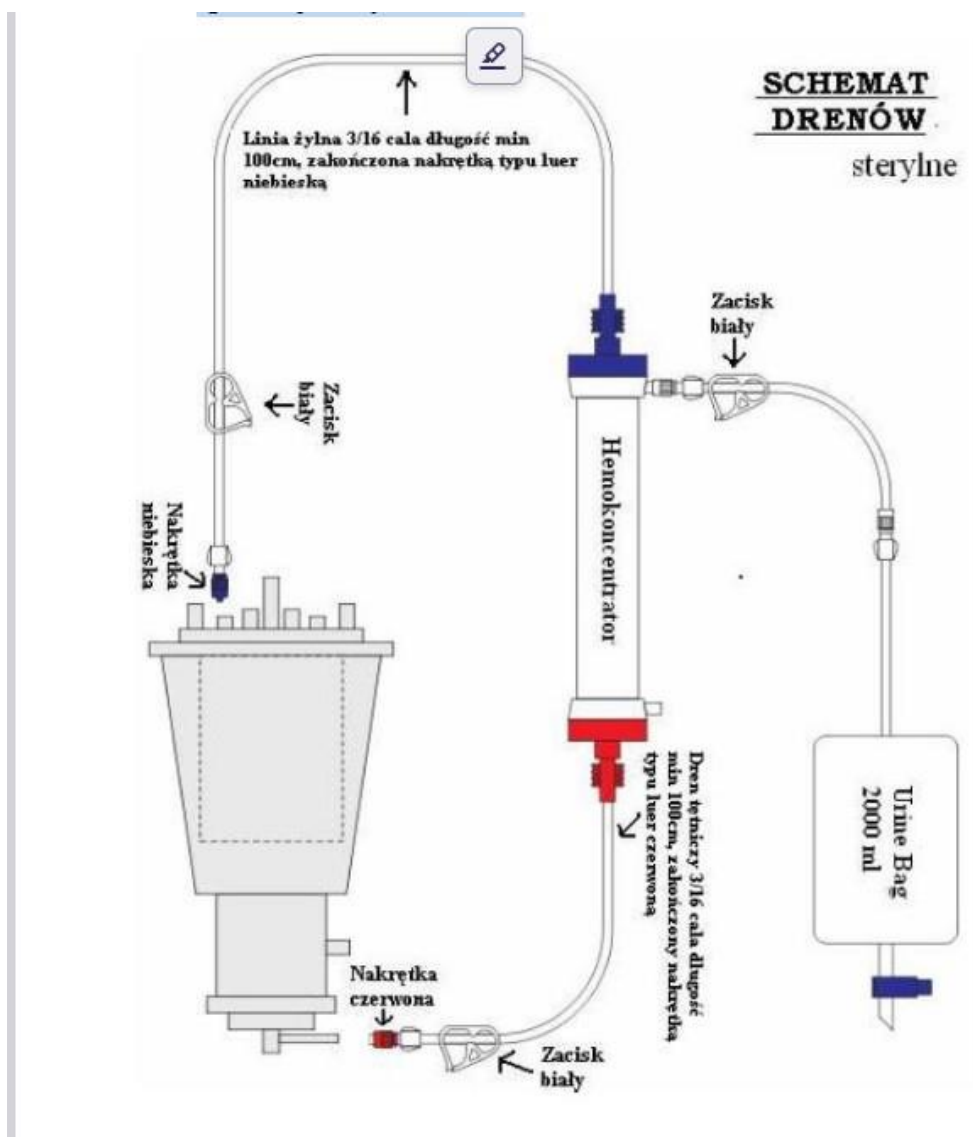

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SWZ określił minimalne parametry, które musi spełnić wymagany produkt. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

