



INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrznie w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 129kPa. Zgodny z normą PN EN 13795. Dodatkowo w opakowaniu ręczniczki włókninowe 20 x 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 8


Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny przeznaczony do operacji o standardowym ryzyku. wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch jest luźny, szeroki, zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch oraz kończyny dolne i górne. Dokładnie opina nadgarstki poliestrowymi ściągaczami wykonanymi z niepyłącego materiału o dł. 8 cm. Szwy łączone są ultradźwiękowo, dzięki czemu tworzą dodatkową barierę dla płynów. Fartuch zaprojektowany jest w taki sposób, aby możliwe było wiązanie najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Złożenie „book-folded”. Jednocześnie zabezpiecza przed przedostawaniem się zakaźnych płynów na ciało personelu zabiegowego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzącą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończone lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep, troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaj fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Fartuch bez lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:



Opis składnika	Ilość
POKROWIEC NA KONCZYNE w rozmiarze 120X75CM	2
SERWETA w rozmiarze 180X75CM z otworem 10X20 cm, przylepcem i 2 wycięciami	1
SERWETA L2 90X75CM	1
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włókna polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa. Gramatura laminatu 55 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro 241 kPa, na sucho 247 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, nasiąkliwość 28,80 % wg metody badań EN ISO 9073-11.


Odpowiedź: Zamawiający *podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

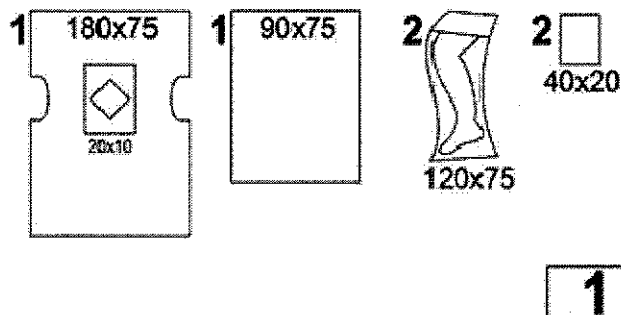

Opis składnika	Ilość
POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ 120X75CM	2
SERWETA w rozmiarze 180X75CM z otworem 10X20 cm, przylepcem i 2 wycięciami	1
SERWETA 90X75CM	1
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włókna polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa. Gramatura laminatu 55 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro 241 kPa, na sucho 247 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, nasiąkliwość 28,80 % wg metody badań EN ISO 9073-11.

Odpowiedź: Zamawiający *podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 21

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującej charakterystyce:

Rozmiar	Rozmiar (dodatkowej) lamy chłonnej w obszarze głownych	Rozmiar szalik w opakowaniu	
Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną, wycięciem U 100x20 cm i przylepcem		260x230 cm 120x80 cm	1
Serweta z laminatu 2-warstwowego z warstwą chłonną i przylepcem		150x240 cm 37,5x60 cm	1
Serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu)		190x150 cm	1
Pokrowiec na stolik Mayo		145x80 cm	1
Pokrowiec na kończynę L2		120x37 cm	1
Taśma medyczna BP samoprzylepna		9x50 cm	6
Kieszon foliowa z kształtką i przylepcem		40x30 cm	1
Ręczniczki włókninowe 40 g 4-warstwowe		10x20 cm	2

Zestaw wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO13485

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z REF, lot, datą ważności i nazwą identyfikującą

Wykonawcę. Materiał serwet głównych

Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 g/m².

Pad chłonne w obszarach krytycznych – gramatura 60 g/m² – łączna gramatura laminatu w obszarze krytycznym mi. 115g/m².



Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana.

Folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego.

Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O, odporności wytrzymałości na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, o odporności wytrzymałości na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 481,7 %

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującej charakterystyce:

Skład	Rozmiar	Rozmiar dodatkowej łaty chłonnej w serwetkach głównych	Ilość sztuk w opakowaniu
Serweta z laminatu 2-warstwowego (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60 cm	240x150 cm	37,5x60 cm	1
Serweta z laminatu 2-warstwowego (stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60 cm	200x170 cm	37,5x60 cm	1
Serweta z laminatu 2-warstwowego (boki) z łatą chłonną i przylepcem 5x90 cm	90x75 cm	37,5x60 cm	2
Serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu)	190x150 cm		1
Pokrowiec na stolik Mayo	145x80 cm		1
Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50 cm		1
Ręczniczki włókninowe 40 g 4-warstwowe	10x20 cm		2

Materiał serwet głównych

Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

g/m².

Pad chłonne w obszarach krytycznych – gramatura 60 g/m² – łączna gramatura laminatu w obszarze krytycznym mi. 115g/m².

Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana.

Folia laminatu została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego.

Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H₂O, odporności wytrzymałości na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, o odporności wytrzymałości na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 481,7 %

Laminat wolny od lateksu, I klasa palności.

Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

Podwójne opakowanie – karton zewnętrzny i karton dispenser.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Poz. 3




Czy Zamawiający dopuści organizery na przewody w rozmiarze 15 x 10 cm, samoprzylepny, z trzema otworami o średnicy 2 cm, opakowanie zbiorcze 300 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 22

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującej charakterystyce:



SERWETA 55 g/m² 113X90CM Z KIESZENIĄ POD POŚLADKI 1szt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM 1 SZT

SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 80X60CM 1 SZT

KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 12W 10 SZT

CZAPECZKA DLA NOWORODKA BAWELNA 100% ROZMIAR 38 1 SZT

KOCYK FLANELOWY 80X75CM 1 SZT


SERWETA min. 43 G/M2 90X80CM 1 SZT

Parametry serwety głównej: laminat dwuwarstwowy 55 g/m2, wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho i na mokro min. 241 kPa

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującej charakterystyce:

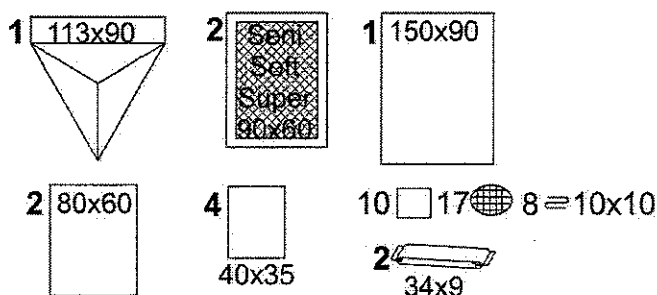

SERWETA 55 g/m2 113X90CM Z KIESZ POD POŚLADKI 1 szt

SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 80X60CM 2 szt

SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 40X35CM 4 szt

KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 8W 10 szt

SERWETA min. 43 g/m2 150X90CM 1 szt

ABSORGYN PODKŁAD GINEKOLOGICZNY 34X9CM Z FOLIĄ 2 szt

PODKŁAD 90X60CM 2 szt

Parametry serwety głównej: laminat dwuwarstwowy 55 g/m2, wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho i na mokro min. 241 kPa

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 7 – dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 7

Czy zamawiający dopuszcza fartuch zgodnie z opisem?

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²
- wzmocnienie PE 40 g/m² (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm)
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiające aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho ≥ 40 kPa, na mokro ≥ 40 kPa
- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N
- pyłność $\log_{10} \leq 4,0$
- penetracja płynu ≥ 20 cmH₂O
- rozmiary:

S 115 x 140 cm

M 125 x 145 cm

L 130 x 150 cm

XL 140 x 160 cm

XXL 160 x 160 cm

- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuszcza fartuch zgodnie z opisem?

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho ≥ 40 kPa, na mokro ≥ 40 kPa
- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N
- pyłność $\log_{10} \leq 4,0$
- penetracja płynu ≥ 20 cmH₂O
- rozmiary:
 - S 115 x 140 cm
 - M 125 x 145 cm
 - L 130 x 150 cm
 - XL 140 x 160 cm
 - XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Marta Cierpka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak



**DOLNY
ŚLĄSK**